

LIBAD4

Bibliothek für Programmierschnittstelle LIBAD4

Programmierhandbuch

Version 4.5

► www.bmcm.de

bavarian measurement company munich



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1 Überblick | 7 |
| 1.1 Einleitung | 7 |
| 1.2 BMC Messsysteme GmbH | 9 |
| 1.3 Urheberrechte | 10 |
| 2 Installation | 11 |
| 2.1 Installation unter Windows® | 11 |
| 2.2 Installation unter Mac OS X | 11 |
| 2.3 Installation unter FreeBSD | 14 |
| 2.4 Installation unter Linux | 16 |
| 2.5 Weitergabe der Bibliothek | 18 |
| 3 Grundlagen | 19 |
| 3.1 Einführung | 19 |
| 4 Einzelwerterfassung | 21 |
| 4.1 Funktionsbeschreibung (Einzelwerte) | 21 |
| 4.1.1 ad_open | 21 |
| 4.1.2 ad_close | 24 |
| 4.1.3 ad_get_range_count | 24 |
| 4.1.4 ad_get_range_info | 25 |
| 4.1.5 ad_discrete_in | 26 |
| 4.1.6 ad_discrete_in64 | 27 |
| 4.1.7 ad_discrete_inv | 28 |
| 4.1.8 ad_discrete_out | 30 |
| 4.1.9 ad_discrete_out64 | 31 |
| 4.1.10 ad_discrete_outv | 32 |
| 4.1.11 ad_sample_to_float | 33 |
| 4.1.12 ad_sample_to_float64 | 34 |
| 4.1.13 ad_float_to_sample | 35 |

| | | |
|--------|-----------------------|----|
| 4.1.14 | ad_float_to_sample64 | 36 |
| 4.1.15 | ad_analog_in | 37 |
| 4.1.16 | ad_analog_out | 37 |
| 4.1.17 | ad_digital_in | 38 |
| 4.1.18 | ad_digital_out | 38 |
| 4.1.19 | ad_set_digital_line | 38 |
| 4.1.20 | ad_get_digital_line | 39 |
| 4.1.21 | ad_get_line_direction | 39 |
| 4.1.22 | ad_set_line_direction | 40 |
| 4.1.23 | ad_get_version | 40 |
| 4.1.24 | ad_get_drv_version | 41 |

5 Scanvorgang 42

| | | |
|---------|--|----|
| 5.1 | Einführung | 42 |
| 5.2 | Scanparameter | 42 |
| 5.2.1 | struct ad_scan_cha_desc | 43 |
| 5.2.1.1 | Speicherarten | 44 |
| 5.2.1.2 | Triggerarten | 45 |
| 5.2.2 | struct ad_scan_desc | 46 |
| 5.2.3 | struct ad_scan_state | 48 |
| 5.3 | Memory-only Scan | 50 |
| 5.3.1 | Starten eines Scans | 50 |
| 5.3.2 | Auslesen der Messwerte | 51 |
| 5.3.3 | Stoppen des Scans | 53 |
| 5.4 | Kontinuierliche Messung | 54 |
| 5.4.1 | Aufbau eines RUNs | 54 |
| 5.4.2 | Ein Messwert pro RUN | 56 |
| 5.4.3 | Signale mit unterschiedlicher Speicherrate | 58 |
| 5.5 | Messung mit Triggerung | 60 |
| 5.6 | Funktionsbeschreibung (Scan) | 61 |
| 5.6.1 | ad_start_mem_scan | 61 |
| 5.6.2 | ad_start_scan | 62 |
| 5.6.3 | ad_get_sample_layout | 63 |
| 5.6.4 | ad_get_samples | 64 |
| 5.6.5 | ad_get_samples_f | 65 |
| 5.6.6 | ad_get_samples_f64 | 66 |
| 5.6.7 | ad_calc_run_size | 67 |

| | | |
|--------|---------------------|----|
| 5.6.8 | ad_get_next_run | 69 |
| 5.6.9 | ad_get_next_run_f | 70 |
| 5.6.10 | ad_get_next_run_f64 | 70 |
| 5.6.11 | ad_poll_scan_state | 71 |
| 5.6.12 | ad_stop_scan | 72 |

6 Messsysteme **73**

| | | |
|---------|--|-----|
| 6.1 | Hinweise | 73 |
| 6.2 | iM-AD25a / iM-AD25 / iM3250T / iM3250 | 74 |
| 6.2.1 | Kanalnummern iM-AD25a / iM-AD25 | 75 |
| 6.2.2 | Kanalnummern iM3250T | 75 |
| 6.2.3 | Kanalnummern iM3250 | 76 |
| 6.3 | LAN-AD16f | 77 |
| 6.3.1 | Kanalnummern LAN-AD16f | 77 |
| 6.3.2 | Konfiguration des Zählers | 79 |
| 6.4 | PCIe-BASE / PCI-BASEII/300/1000/PIO | 82 |
| 6.4.1 | Digitalports und Zähler | 82 |
| 6.4.1.1 | PCIe-BASE | 82 |
| 6.4.1.2 | PCI-BASEII / PCI-PIO | 83 |
| 6.4.1.3 | PCI-BASE300 / PCI-BASE1000 | 83 |
| 6.4.1.4 | Konfiguration der Zähler | 84 |
| 6.4.2 | Aufsteckmodule | 88 |
| 6.4.2.1 | MAD12/12a/12b/12f/16/16a/16b/16f | 88 |
| 6.4.2.2 | MADDA16/16n | 89 |
| 6.4.2.3 | MDA12/12-4/16/16-2i/16-4i/16-8i | 91 |
| 6.4.2.4 | Funktionsgenerator der MDA16i-2i/-4i/-8i | 92 |
| 6.5 | meM-AD /-ADDA /-ADf / -ADfo | 97 |
| 6.5.1 | Eckdaten und Kanalnummern meM-Geräte | 97 |
| 6.6 | meM-PIO / meM-PIO-OEM | 99 |
| 6.6.1 | Eckdaten und Kanalnummern meM-PIO(-OEM) | 99 |
| 6.7 | USB-AD / USB-PIO / USB-PIO-OEM | 100 |
| 6.7.1 | Eckdaten und Kanalnummern USB-AD | 102 |
| 6.7.2 | Eckdaten und Kanalnummern USB-PIO(-OEM) | 103 |
| 6.8 | USB-AD12f | 103 |
| 6.8.1 | Eckdaten und Kanalnummern USB-AD12f | 104 |
| 6.9 | USB-AD16f | 105 |
| 6.9.1 | Eckdaten und Kanalnummern USB-AD16f | 105 |

1 Überblick

1.1 Einleitung

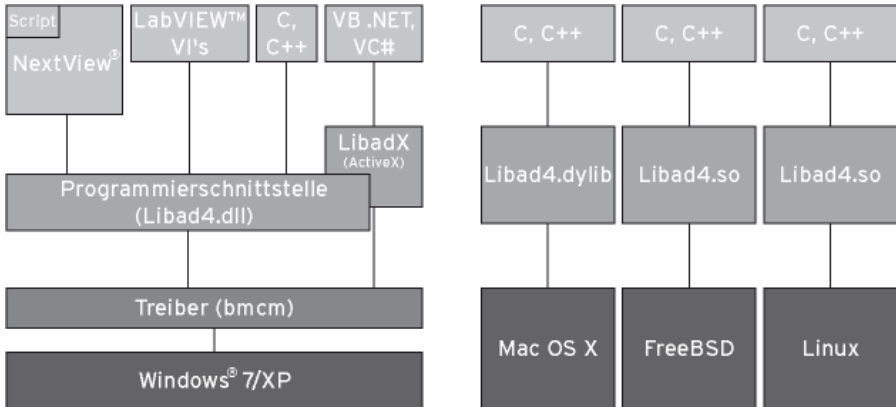


Abbildung 1

Die Bibliothek **LIBAD4** ist eine Schnittstelle zu allen Messsystemen der BMC Messsysteme GmbH. Diese Schnittstelle erlaubt zum Beispiel das Lesen und Schreiben von Einzelwerten, wie das Einlesen eines Analogeingangs oder das Ausgeben eines Werts an einen Analogausgang.

Neben der Ein-/Ausgabe von Einzelwerten kann mit der **LIBAD4** eine Messung durchgeführt werden. Dieser Scan der Eingangskanäle findet im entsprechenden Treiber statt und ist deshalb zeitlich von der Applikation entkoppelt. Damit ist es möglich, schnell und ohne Verlust von Messwerten die Eingangskanäle abzutasten.

Die **LIBAD4** liegt sowohl für Windows[®] 7/XP, als auch für Mac OS X, FreeBSD und Linux vor. Damit ist es ohne Änderung des Sourcecodes möglich, Messsysteme der BMC Messsysteme GmbH Plattform übergreifend einzusetzen.



- **LIBAD4 ist eine 32-Bit Schnittstelle. Für 64-Bit Systeme muss die Applikation als 32-Bit Applikation erstellt werden.**
 - **Bitte beachten Sie, dass alle Beispielcodes in diesem Handbuch aus Gründen der Einfachheit bewusst auf eine Fehlerbehandlung verzichten. Selbstverständlich muss diese in selbst geschriebenen Programmen realisiert werden.**
-

1.2 BMC Messsysteme GmbH



BMC Messsysteme GmbH steht für innovative Messtechnik "made in Germany". Vom Sensor bis zur Software bieten wir alle für die Messkette benötigten Komponenten an.

Unsere Hard- und Software ist aufeinander abgestimmt und dadurch besonders anwenderfreundlich. Darüber hinaus legen wir größten Wert auf die Einhaltung gängiger Industriestandards, die das Zusammenspiel vieler Komponenten erleichtern.

BMC Messsysteme Produkte finden Sie im industriellen Großeinsatz ebenso wie in Forschung und Entwicklung oder im privaten Anwenderbereich. Wir fertigen unter Einhaltung der ISO-9000-Vorschriften, denn Standards und Zuverlässigkeit sind uns wichtig - für Sie und für uns!

Neueste Informationen finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter <http://www.bmcm.de>.

► www.bmcm.de
bavarian measurement company munich

1.3 Urheberrechte

Die Programmierschnittstelle **LIBAD4** mit allen Erweiterungen wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und geprüft. Die BMC Messsysteme GmbH gibt keine Garantien, weder in Bezug auf dieses Handbuch noch in Bezug auf die in diesem Buch beschriebene Hard- und Software, ihre Qualität, Durchführbarkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck. Die BMC Messsysteme GmbH haftet in keinem Fall für direkt oder indirekt verursachte oder erfolgte Schäden, die entweder aus unsachgemäßer Bedienung oder aus irgendwelchen Fehlern am System resultieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.

Die Programmierschnittstelle **LIBAD4** sowie das vorliegende Handbuch und sämtliche darin verwendeten Namen, Marken, Bilder und sonstige Bezeichnungen und Symbole sind ihrerseits gesetzlich sowie aufgrund nationaler und internationaler Verträge geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Reproduktion der Programme und des Programmhandbuchs sowie die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Ihre rechtswidrige Verwendung oder sonstige rechtliche Beeinträchtigung wird straf- und zivilrechtlich verfolgt und kann zu empfindlichen Sanktionen führen.

Copyright © 2011

Stand: 11. Oktober 2011

BMC Messsysteme GmbH

Hauptstraße 21
82216 Maisach
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 8141/404180-1

Fax: +49 8141/404180-9

E-Mail: info@bmcm.de

2 Installation

2.1 Installation unter Windows®



Unter Windows® ist die **LIBAD4** als "dynamic link library" realisiert. Das Installationsprogramm kopiert die Bibliothek inklusive aller Headerfiles und den Beispielprogrammen auf die Festplatte.

Damit Programme auf die **libad4.dll** zugreifen können, sollte diese in das entsprechende Programmverzeichnis kopiert werden.



Alle Funktionen der LIBAD4 verwenden die Aufrufkonventionen *cdecl* von C. Soll die Bibliothek unter einer anderen Programmiersprache als C/C++ verwendet werden, muss sichergestellt werden, dass diese die Aufrufkonventionen von C für die LIBAD4 Funktionen verwendet.

2.2 Installation unter Mac OS X



Unter Mac OS X ist die **LIBAD4** als "dynamic library" realisiert und wird als Disk Image ausgeliefert.

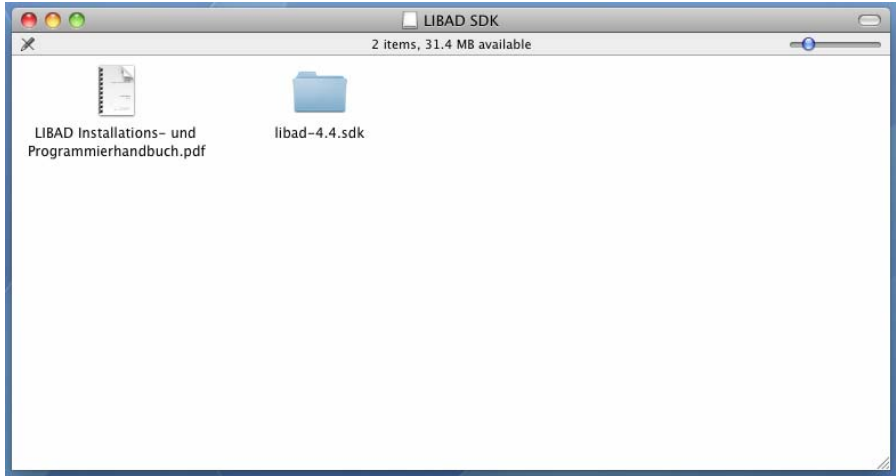


Abbildung 2

In diesem Disk Image befinden sich neben dem Installations- und Programmierhandbuch auch die Headerdateien, die eigentliche Bibliothek und die Beispielprogramme.



Abbildung 3

Damit die Programme auf die dynamic library zugreifen können, muss diese in ein Verzeichnis kopiert werden, in dem der dynamic linker shared libraries erwartet. Genaue Hinweise dazu entnehmen Sie bitte der manpage von `dyld`.

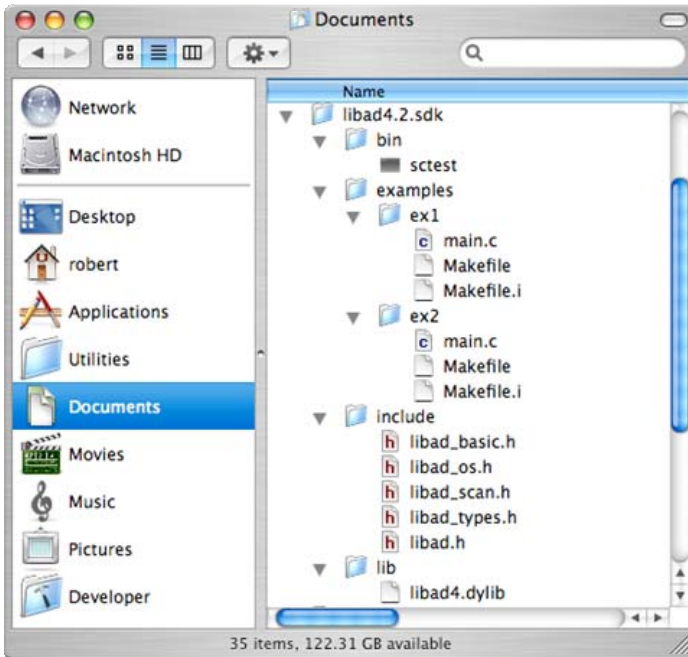


Abbildung 4

Folgender Befehl kopiert die **LIBAD4** nach `/usr/local/lib`:

```
root# cp lib/libad.dylib /usr/local/lib
root#
```

2.3 Installation unter FreeBSD



Unter FreeBSD wird die **LIBAD4** als gepacktes TAR File ausgeliefert. Das File kann mit folgendem Befehl ausgepackt werden (bitte passen Sie die Versionsnummer an die Version der verwendeten LIBAD an).

```
bash# tar xjf libad-freebsd-4.4.412.tar.bz2
bash#
```

Nach dem Auspacken befinden sich folgende Dateien auf der Festplatte:

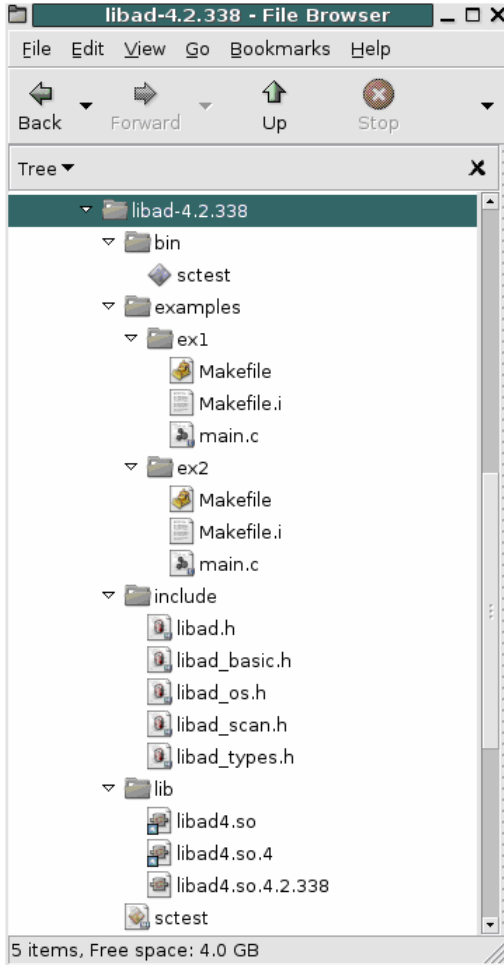


Abbildung 5

Unter FreeBSD ist die **LIBAD4** als "shared library" realisiert. Damit die Programme auf die Bibliothek zugreifen können, muss diese in ein Verzeichnis kopiert werden, in dem der dynamic linker shared libraries erwartet. Genaue Hinweise dazu entnehmen Sie bitte der manpage von **ldconfig** bzw. **ld-elf.so.1**.

Ist Ihr System so eingerichtet, dass shared libraries in `/usr/local/lib` berücksichtigt werden, dann kopieren Sie bitte `libad4.so.4.4.412` nach `/usr/local/lib`. Legen Sie dann zwei symbolische Links `/usr/local/lib/libad4.so.4` und `/usr/local/lib/libad4.so` an, so dass diese auf `/usr/local/lib/libad4.so.4.4.412` zeigen (die Versionsnummer Ihrer **LIBAD4** ist eventuell eine andere und muss entsprechend angepasst werden).

Folgende Befehle führen die notwendigen Aktionen aus:

```
bash# cp lib/libad4.so.4.4.412 /usr/local/lib/libad4.so.4.4.412
bash# ln -sf libad4.so.4.4.412 /usr/local/lib/libad4.so.4
bash# ln -sf libad4.so.4.4.412 /usr/local/lib/libad4.so
bash# /sbin/ldconfig
bash#
```

2.4 Installation unter Linux



Unter Linux wird die **LIBAD4** als gepacktes TAR File ausgeliefert. Das File kann mit folgendem Befehl ausgepackt werden (bitte passen Sie die Versionsnummer an die Version der verwendeten LIBAD an).

```
bash# tar xjf libad-linux-4.4.412.tar.bz2
bash#
```

Nach dem Auspacken befinden sich folgende Dateien auf der Festplatte:

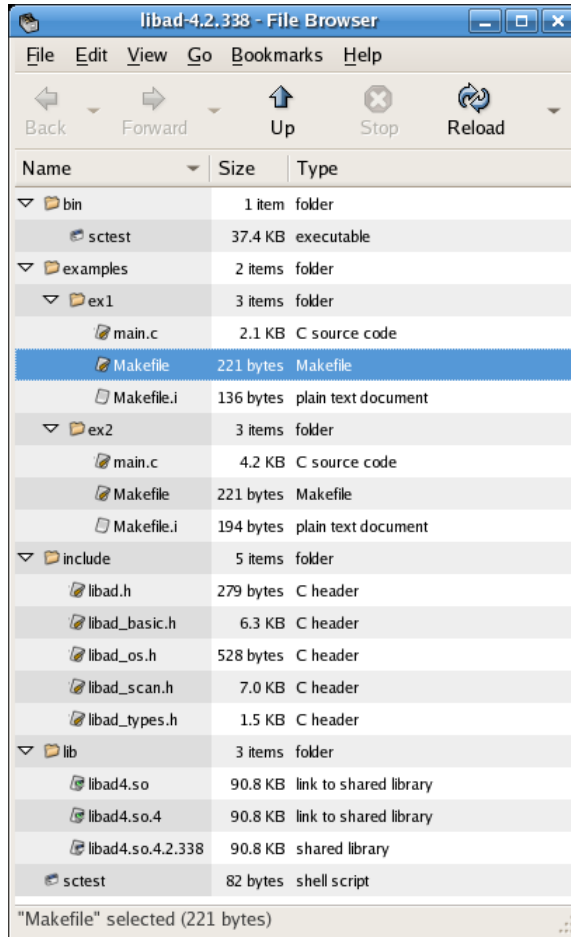


Abbildung 6

Unter Linux ist die **LIBAD4** als "shared library" realisiert. Die Bibliothek ist für 32-Bit Systeme übersetzt. Damit die Programme auf die Bibliothek zugreifen können, muss diese in ein Verzeichnis kopiert werden, in dem **ldconfig** shared libraries erwartet. Genaue Hinweise dazu entnehmen Sie bitte der manpage von **ldconfig** bzw. der Datei **/etc/ld.so.conf**.

Ist Ihr System so eingerichtet, dass shared libraries in **/usr/local/lib** berücksichtigt werden, dann kopieren Sie bitte **libad4.so.4.4.412** nach

`/usr/local/lib`. Legen Sie dann zwei symbolische Links `/usr/local/lib/libad4.so.4` und `/usr/local/lib/libad4.so` an, so dass diese auf `/usr/local/lib/libad4.so.4.4.412` zeigen (die Versionsnummer Ihrer **LIBAD4** ist eventuell eine andere und muss entsprechend angepasst werden). Folgende Befehle führen die notwendigen Aktionen aus:

```
bash# cp lib/libad4.so.4.4.412 /usr/local/lib/libad4.so.4.4.412
bash# ln -sf libad4.so.4.4.412 /usr/local/lib/libad4.so.4
bash# ln -sf libad4.so.4.4.412 /usr/local/lib/libad4.so
bash# /sbin/ldconfig
bash#
```

2.5 Weitergabe der Bibliothek

Damit eine Applikation auf die Funktionen der **LIBAD4** Bibliothek zugreifen kann, muss jene auf dem Zielsystem installiert werden. Aus diesem Grund ist die Weitergabe der folgenden Files ausdrücklich erlaubt (die Versionsnummer Ihrer **LIBAD4** ist eventuell eine andere und muss entsprechend angepasst werden).

```
libad4.dll
libad4.dylib
libad4.so.4.4.412
```

Es ist Aufgabe des Installationsprogramms der erstellten Applikation, das entsprechende File zusammen mit der Applikation zu installieren. Auf keinen Fall sollte das LIBAD4 SDK verwendet werden, um die LIBAD4 Bibliothek auf dem Zielrechner zu installieren.



Bitte beachten Sie, dass alle anderen Files aus dem LIBAD4 SDK nicht weitergegeben werden dürfen!

3 Grundlagen

3.1 Einführung

Die von **LIBAD4** exportierten Funktionen und die verwendeten Konstanten werden einem C/C++ Programm in der Headerdatei **libad.h** zur Verfügung gestellt.



Die exakten Definitionen der in diesem Handbuch beschriebenen C/C++ Aufrufe und Strukturen sind in den aktuellen Headerdateien definiert.

Die **LIBAD4** stellt zwei Funktionen zur Verfügung, mit denen ein Messsystem geöffnet bzw. wieder geschlossen werden kann. Mit der Funktion **ad_open()** wird ein Messsystem geöffnet, mit **ad_close()** wieder geschlossen. Folgendes Beispiel demonstriert das prinzipielle Vorgehen:



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <code>int32_t ad_open (const char *name);</code> |
|------------------|--|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>#include "libad.h" ... int32_t adh; ... adh = ad_open ("usb-ad"); if (adh == -1) { printf ("failed to open USB-AD driver\n"); exit (1); } ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|--|

Der Funktion **ad_open()** wird der Name des Messsystems übergeben. Der übergebene String wird ohne Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung verwendet, d. h. "usb-ad" und "USB-AD" öffnen beide das USB-AD. Als Rückgabewert liefert die Funktion einen Handle, der in allen weiteren Aufrufen an die **LIBAD4** benötigt wird. Im Fehlerfall wird **-1** zurückgegeben. Die Fehlernummer lässt sich unter Windows[®] mit **GetLastError()** abfragen.

Es ist durchaus auch möglich, mehrere Messsysteme gleichzeitig zu öffnen, **ad_open()** gibt dann für jeden geöffneten Treiber einen anderen Handle zurück. Genaue Hinweise dazu entnehmen Sie bitte der Beschreibung der Funktion **ad_open()**, Seite 21.

Die unterstützten Messsysteme sind im Kapitel "Messsysteme" ab Seite 73 beschrieben. Dort sind auch die benötigten Kanalnummern für die Ein- und Ausgangskanäle und die entsprechenden Messbereiche definiert.

Sobald ein Messsystem geöffnet worden ist, lassen sich Messwerte von den Eingängen einlesen (s. "**ad_discrete_in**", S. 26) oder die Werte für die Ausgänge festlegen (s. "**ad_discrete_out**", S. 30). Genaue Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Einzelwert erfassung", Seite 21.

Neben der Einzelwertabfrage von Messwerten kann die **LIBAD4** auch einen Scanvorgang starten. Dieser tastet mehrere Eingangskanäle in einem festen Zeitraster ab und liefert die erfassten Messwerte in einem Buffer zurück. Das Programmieren eines Scans ist im Kapitel "Scanvorgang" ab Seite 42 beschrieben.

Die Abfrage von Einzelwerten führt dazu, dass pro Abfrage ein Befehl zum Messsystem geschickt werden muss. Bei der Programmierung eines Scans wird nur beim Start der Messung ein Befehl an das Gerät geschickt. Danach sendet das Messsystem kontinuierlich Messdaten.

Nachdem die Befehlsübertragung immer mit einer gewissen Latenzzeit behaftet ist, kann aus diesem Grund die Abfrage von Einzelwerten niemals in der Geschwindigkeit durchgeführt werden, die bei der Programmierung eines Scans erreicht wird.

4 Einzelwerterfassung

4.1 Funktionsbeschreibung (Einzelwerte)



Alle Funktionen der LIBAD4 sind thread-safe, solange dies in der Funktionsbeschreibung nicht ausdrücklich anders spezifiziert ist.

4.1.1 ad_open



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <code>int32_t ad_open (const char *name);</code> |
|------------------|--|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>#include "libad.h" ... int32_t adh; ... adh = ad_open ("usb-ad"); if (adh == -1) { printf ("failed to open USB-AD\n"); exit (1); } ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|--|

Die Funktion `ad_open()` stellt eine Verbindung zum Messsystem her. Es wird der Name des Messsystems übergeben. Der übergebene String wird ohne Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung verwendet, d. h. "`pcibase`" und "`PCIBase`" öffnen beide eine PCIe-BASE / PCI-BASEII/300/1000/PIO. Als Rückgabewert liefert die Funktion einen Handle, der in allen weiteren Aufrufen an die **LIBAD4** benötigt wird. Im Fehlerfall wird `-1` zurückgegeben. Die Fehlernummer lässt sich unter Windows® mit `GetLastError()` erfragen.

Es ist durchaus möglich, mehrere (verschiedene) Messsysteme zu öffnen, `ad_open()` gibt dann für jeden geöffneten Treiber einen anderen Handle zurück.

Gerätespezifische Informationen (z. B. Name des Messsystems) zu den unterstützten Messsystemen sind in den gleichnamigen Kapiteln enthalten:

- iM-AD25a / iM-AD25 / iM3250T / iM3250
- PCIe-BASE / PCI-BASEII/300/1000/PIO
- meM-AD /-ADDA /-ADf / -ADfo / meM-PIO / meM-PIO-OEM
- USB-AD / USB-PIO / USB-PIO-OEM / USB-AD12f / USB-AD16f

Folgendes Beispiel öffnet ein USB-AD und eine USB-PIO:



```
C #include "libad.h"
...
int32_t adh1;
int32_t adh2;
...

adh1 = ad_open ("usb-ad");
adh2 = ad_open ("usb-pio");

...

ad_close (adh1);
ad_close (adh2);
```

Sollen mehrere Messsysteme gleichen Typs geöffnet werden, dann ist die Nummer des Messsystems mit Doppelpunkt getrennt an den Namen anzuhängen. Folgendes Beispiel öffnet zwei USB-AD Geräte:



```
C #include "libad.h"

...
int32_t adh1;
int32_t adh2;
...

    adh1 = ad_open ("usb-ad:0");
    adh2 = ad_open ("usb-ad:1");
...

    ad_close (adh1);
    ad_close (adh2);
```

Alternativ lässt sich ein Messsystem über seine Seriennummer öffnen. Dabei ist die Seriennummer mit einem @ Zeichen nach dem Doppelpunkt anzugeben.

Das folgende Beispiel öffnet die zwei USB-AD Geräte mit den Seriennummern 157 und 158.



```
C #include "libad.h"

...
int32_t adh1;
int32_t adh2;
...

    adh1 = ad_open ("usb-ad:@157");
    adh2 = ad_open ("usb-ad:@158");
...

    ad_close (adh1);
    ad_close (adh2);
```

4.1.2 ad_close



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_close (int32_t adh);</pre> |
|------------------|--|

| | |
|----------|---|
| C | <pre>#include "libad.h" ... int32_t adh; ... adh = ad_open ("usb-ad"); if (adh == -1) { printf ("failed to open USB-AD\n"); exit (1); } ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|---|

Die Funktion **ad_close()** schließt ein Messsystem wieder. Der Rückgabewert der Funktion ist 0 oder im Fehlerfall die entsprechende Fehlernummer.

4.1.3 ad_get_range_count



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_get_range_count (int32_t adh, int32_t cha, int32_t cnt);</pre> |
|------------------|--|

Die Funktion **ad_get_range_count()** liefert die Anzahl der Messbereiche des Kanals **cha** zurück.

4.1.4 ad_get_range_info



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre> struct ad_range_info { double min; double max; double res; ... int bps; char unit[24]; }; int32_t ad_get_range_info (int32_t adh, int32_t cha, int32_t range, struct ad_range_info *info); </pre> |
|------------------|--|

| | |
|----------|--|
| C | <pre> #include "libad.h" ... int32_t adh; int32_t cnt; int32_t cha; struct ad_range_info info; ... adh = ad_open ("usbbase"); cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN; rc = ad_get_range_count(adh, cha, &cnt); for (i=0;i < cnt; i++) { rc = ad_get_range_info(adh, cha, i, &info); ... } ... ad_close (adh); </pre> |
|----------|--|

Die Funktion **ad_get_range_info()** liefert die Messbereichsinformation des Messbereichs **range** des Kanals **cha** zurück.

4.1.5 ad_discrete_in



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_discrete_in (int32_t adh, int32_t cha, int32_t range, uint32_t *data);</pre> |
|------------------|--|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>int32_t adh; int32_t st; uint32_t data; ... adh = ad_open ("usb-ad"); st = ad_discrete_in (adh, AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN 1, 0, &data) ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|--|

Die Funktion **ad_discrete_in()** liefert einen Einzelwert des angegebenen Kanals. Dabei wird im Parameter **cha** neben der eigentlichen Kanalnummer noch der Kanaltyp angegeben:

- **AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN** für Analogeingänge
- **AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT** für Analogausgänge
- **AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO** für Digitalkanäle
- **AD_CHA_TYPE_COUNTER** für Zählerkanäle

Je nach Messsystem stehen unterschiedliche Kanäle zur Verfügung. Diese sind im Kapitel "Messsysteme" (s. S. 73) dokumentiert. Neben der Kanalnummer wird der Funktion noch der Messbereich übergeben, in dem der Eingangskanal abgetastet werden soll. Der Messbereich wird für digitale Kanäle ignoriert.

Die Funktion **ad_discrete_in()** liefert für analoge Kanäle in ***data** einen Wert zwischen **0x00000000** und **0xffffffff** zurück. Dabei entspricht der Wert **0x00000000** der unteren Messbereichsgrenze, der Wert **0x10000000** der oberen Messbereichsgrenze (dieser Wert wird bei 32 Bit nicht erreicht, und daher maximal **0xffffffff** zurückgegeben). Der Wert **0x80000000**

entspricht der Messbereichsmittle, bei einem symmetrischen, bipolaren Eingang also 0.0V.

Für die Umrechnung eines solchen Werts in einen Spannungswert steht die Funktion `ad_sample_to_float()` zur Verfügung. Die Hilfsfunktion `ad_analog_in()` übergibt den Messwert direkt als Spannung.

Die Kanalnummer und die Nummer des Messbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.6 ad_discrete_in64



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_discrete_in64 (int32_t adh, int32_t cha, uint64_t range, uint64_t *data)</pre> |
|------------------|---|

| | |
|----------|---|
| C | <pre>int32_t adh; int32_t st; uint64_t data; ... adh = ad_open ("usb-ad"); st = ad_discrete_in64 (adh, AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN 1, 0, &data) ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|---|

Die Funktion `ad_discrete_in64()` liefert einen Einzelwert des angegebenen Kanals. Neben der Kanalnummer wird der Funktion noch der Messbereich übergeben, in dem der Eingangskanal abgetastet werden soll. Der Messbereich wird für digitale Kanäle ignoriert.

Die Funktion `ad_discrete_in64()` liefert einen Wert zwischen `0x0000000000000000` (der unteren Messbereichsgrenze) und

0x1000000000000000 (der oberen Messbereichsgrenze). Die vollen 64 Bit werden nur von speziellen 64-Bit Messsystemen benutzt. Der Wert **0x8000000000000000** entspricht der Messbereichsmitte, bei einem symmetrischen, bipolaren Eingang also 0.0V.

Für die Umrechnung eines solchen Werts in einen Spannungswert steht die Funktion **ad_sample_to_float64()** zur Verfügung. Die Hilfsfunktion **ad_analog_in()** übergibt den Messwert direkt als Spannung.

Die Kanalnummer und die Nummer des Messbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.7 ad_discrete_inv



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_discrete_inv (int32_t adh, int32_t chac, int32_t chav[], uint64_t rangev[], uint64_t datav[]);</pre> |
|------------------|--|

```

C      #define CHAC 3

uint64_t rangev[CHAC], datav[CHAC];
int32_t chav[CHAC], adh, i;

/* das Beispiel liest die 3 Kanäle der USB-PIO
  */

adh = ad_open ("usb-pio");
if (adh < 0)
  {
    fprintf (stderr, "error: couldn't open USB-PIO\n");
    return -1;
  }

/* setze den range bei allen Kanälen auf 0 */
memset (rangev, 0, sizeof(*rangev));
for (i = 0; i < CHAC; i++)
  {
    /* Kanalnummer setzen */
    chav[i] = AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|(i+1);
    /* auf Eingang setzen */
    ad_set_line_direction (adh, chav[i], 0xffffffff);
  }

ad_discrete_inv (adh, CHAC, chav, rangev, datav);
ad_close (adh);

```

Die Funktion **ad_discrete_inv()** liest **chac** Eingänge auf einmal. Dabei können analoge und digitale Eingänge gemischt werden. Neben den Kanalnummern werden der Funktion noch die Messbereiche übergeben, in denen die Eingangskanäle betrieben werden.

Im Normalfall wird die Routine **ad_discrete_inv()** etwas schneller abgearbeitet, als der mehrmalige Aufruf der Funktion **ad_discrete_in64()** in einer entsprechenden Schleife.

Im Gegensatz zu **ad_discrete_in()** und **ad_discrete_in64()** werden an **ad_discrete_inv()** Kanalnummern, Messbereiche und Wertvariablen in Feldern übergeben. Die Feldwerte werden dabei analog zu **ad_discrete_in64()** gesetzt.

4.1.8 ad_discrete_out



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_discrete_out (int32_t adh, int32_t cha, int32_t range, uint32_t data);</pre> |
|------------------|---|

| | |
|----------|---|
| C | <pre>int32_t adh; int32_t st; ... adh = ad_open ("usb-ad"); st = ad_discrete_out (adh, AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 1, 0, 0x80000000) ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|---|

Die Funktion **ad_discrete_out()** setzt einen Ausgang. Neben der Kanalnummer wird der Funktion noch ein Ausgangsbereich übergeben, in dem der Ausgangskanal betrieben wird (nur bei Messsystemen, die den Ausgangsbereich softwaremäßig umschalten können). Andernfalls ist softwaremäßig dafür Sorge zu tragen, dass der angegebene Ausgangsbereich mit den Hardwareeinstellungen übereinstimmt.

Wie beim analogen Eingangskanal entspricht der Wert **0x00000000** eines Analogausgangs der niedrigsten Ausgangsspannung, der Wert **0x10000000** der höchsten Ausgangsspannung (da **0x100000000** von 32 Bit nicht erreicht wird, kann **ad_discrete_out()** maximal **0xffffffff** übergeben werden).

Mittels **ad_float_to_sample()** lässt sich ein Spannungswert (float) in einen Digitalwert zur Übergabe an **ad_discrete_out()** umrechnen. Die Hilfsfunktion **ad_analog_out()** übergibt den Messwert direkt als Spannung.

Die Kanalnummer und die Nummer des Ausgangsbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.9 ad_discrete_out64



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_discrete_out64 (int32_t adh, int32_t cha, uint64_t range, uint64_t data);</pre> |
|------------------|---|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>int32_t adh; int32_t st; uint64_t data; ... adh = ad_open ("pci300"); st = ad_float_to_sample64 (adh, AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 1, 0, 0.0f, &data); ... st = ad_discrete_out (adh, AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 1, 0, data) ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|--|

Die Funktion **ad_discrete_out64()** setzt einen Ausgang. Neben der Kanalnummer wird der Funktion noch ein Ausgangsbereich übergeben, in dem der Ausgangskanal betrieben wird (nur bei Messsystemen, die den Ausgangsbereich softwaremäßig umschalten können). Andernfalls ist softwaremäßig dafür Sorge zu tragen, dass der angegebene Ausgangsbereich mit den Hardwareeinstellungen übereinstimmt.

Wie beim analogen Eingangskanal entspricht der Wert **0x0000000000000000** eines Analogausgangs der niedrigsten Ausgangsspannung, der Wert **0x1000000000000000** der höchsten Ausgangsspannung. Die vollen 64 Bit von **ad_discrete_out64()** werden wie bei den Eingängen nur von speziellen 64-Bit Messsystemen genutzt.

Zur Verfügung steht für die Umrechnung eines Spannungswerts (float) in einen Digitalwert zur Ausgabe mittels **ad_discrete_out64()** die Funktion

`ad_float_to_sample64()`. Die Hilfsfunktion `ad_analog_out()` übergibt den Messwert direkt als Spannung.

Die Kanalnummer und die Nummer des Ausgangsbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.10 `ad_discrete_outv`



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_discrete_outv (int32_t adh, int32_t chac, int32_t chav[], uint64_t rangev[], uint64_t datav[]);</pre> |
|------------------|---|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>#define CHAC 3 uint64_t rangev[CHAC], datav[CHAC]; int32_t chav[CHAC], adh, i; /* das Beispiel setzt die 3 Digitalports der USB-PIO * auf die Werte 1, 2 und 4 */ adh = ad_open ("usb-pio"); if (adh < 0) { fprintf (stderr, "error: couldn't open USB-PIO\n"); return -1; } /* setze den range bei allen Kanälen auf 0 */ memset (rangev, 0, sizeof(*rangev)); for (i = 0; i < CHAC; i++) { /* Kanalnummer setzen */ chav[i] = AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO (i+1); /* auf Ausgang setzen */ ad_set_line_direction (adh, chav[i], 0); /* Wert setzen */ datav[i] = 1 << i; } ad_discrete_outv (adh, CHAC, chav, rangev, datav); ad_close (adh);</pre> |
|----------|--|

Die Funktion `ad_discrete_outv()` setzt `chac` Ausgänge auf einmal. Dabei können analoge und digitale Ausgänge gemischt werden. Neben den Kanalnummern werden der Funktion noch die Ausgangsbereiche übergeben, in denen die Ausgangskanäle betrieben werden

Im Normalfall wird die Routine `ad_discrete_outv()` etwas schneller abgearbeitet, als der mehrmalige Aufruf der Funktion `ad_discrete_out64()` in einer entsprechenden Schleife.

Im Gegensatz zu `ad_discrete_out()` und `ad_discrete_out64()` übergibt man an `ad_discrete_outv()` Kanalnummern, Ausgangsbereiche und Werte in Feldern. Die Feldwerte müssen wie in `ad_discrete_out64()` gesetzt werden.

4.1.11 `ad_sample_to_float`



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_sample_to_float (int32_t adh, int32_t cha, int32_t range, uint32_t data float *f);</pre> |
|------------------|--|

| | |
|----------|---|
| C | <pre>int32_t adh; int32_t st, cha, range; uint32_t data; float volt; ... adh = ad_open ("usb-ad"); ... cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN 1; range = 0; st = ad_discrete_in (adh, cha, range, &data) if (st == 0) st = ad_sample_to_float (adh, cha, range, data, &volt) ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|---|

Rechnet einen Messwert in den entsprechenden Spannungswert um.

Die Kanalnummer und die Nummer des Messbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.12 ad_sample_to_float64



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_sample_to_float64 (int32_t adh, int32_t cha, uint64_t range, uint64_t data double *dbl);</pre> |
|------------------|--|

| | |
|----------|---|
| C | <pre>int32_t adh; int32_t st, cha, range; uint64_t data; float volt; ... adh = ad_open ("usb-ad"); ... cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN 1; range = 0; st = ad_discrete_in64 (adh, cha, range, &data); if (st == 0) st = ad_sample_to_float (adh, cha, range, data, &volt); ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|---|

Rechnet einen Messwert in den entsprechenden Spannungswert um.

Die Kanalnummer und die Nummer des Messbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.13 ad_float_to_sample



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_float_to_sample (int32_t adh, int32_t cha, int32_t range, float f, uint32_t *data);</pre> |
|------------------|---|

| | |
|----------|---|
| C | <pre>int32_t adh; int32_t st, cha, range; uint32_t data; ... adh = ad_open ("usb-ad"); ... cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 1; range = 0; st = ad_float_to_sample (adh, cha, range, 3.2, &data); if (st == 0) st = ad_discrete_out (adh, cha, range, data); ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|---|

Rechnet einen Spannungswert in den entsprechenden Messwert um.

Die Kanalnummer und die Nummer des Messbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.14 ad_float_to_sample64



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_float_to_sample64 (int32_t adh, int32_t cha, uint64_t range, double dbl, uint64_t *data);</pre> |
|------------------|---|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>int32_t adh; int32_t st, cha, range; uint64_t data; ... adh = ad_open ("usb-ad"); ... cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 1; range = 0; st = ad_float_to_sample64 (adh, cha, range, 3.2, &data) if (st == 0) st = ad_discrete_out64 (adh, cha, range, data) ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|--|

Rechnet einen Spannungswert in den entsprechenden Messwert um.

Die Kanalnummer und die Nummer des Messbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.15 ad_analog_in



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_analog_in (int32_t adh, int32_t cha, int32_t range, float *volt);</pre> |
|------------------|---|

Diese Hilfsfunktion ruft **ad_discrete_in()** auf und rechnet dann den gemessenen Wert mit **ad_sample_to_float()** in den Spannungswert um. Dabei werden nur analoge Eingänge unterstützt, d. h. intern wird als Kanalnummer **AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|cha** verwendet.

Die Kanalnummer und die Nummer des Messbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.16 ad_analog_out



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_analog_out (int32_t adh, int32_t cha, int32_t range, float volt);</pre> |
|------------------|--|

Diese Hilfsfunktion rechnet den Spannungswert mit **ad_float_to_sample()** um und ruft dann **ad_discrete_out()** auf. Dabei werden nur analoge Ausgänge unterstützt, d. h. intern wird **AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|cha** als Kanalnummer verwendet.

Die Kanalnummer und die Nummer des Messbereichs sind abhängig von der eingesetzten Messhardware und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert (s. "Messsysteme", S. 73).

4.1.17 ad_digital_in



```
Prototype    int32_t
             ad_digital_in (int32_t adh,
                           int32_t cha, uint32_t *data);
```

Diese Hilfsfunktion ruft **ad_discrete_in()** mit der Kanalnummer **AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|cha** auf.

4.1.18 ad_digital_out



```
Prototype    int32_t
             ad_digital_out (int32_t adh,
                             int32_t cha, uint32_t data);
```

Diese Hilfsfunktion ruft **ad_discrete_out()** mit der Kanalnummer **AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|cha** auf.

4.1.19 ad_set_digital_line



```
Prototype    int32_t
             ad_set_digital_line (int32_t adh, int32_t cha,
                                 int32_t line, uint32_t flag);
```

Diese Hilfsfunktion liest den Kanal **AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|cha** und setzt dann entsprechend dem Parameter **flag** die Leitung mit der Nummer **line**.

Ist **flag** gleich 0, wird die Leitung zurückgesetzt, ist **flag** ungleich 0, wird die Leitung gesetzt. Die erste Leitung in einem Digitalkanal hat die Nummer 0.

4.1.20 ad_get_digital_line



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_get_digital_line (int32_t adh, int32_t cha, int32_t line, uint32_t *flag);</pre> |
|------------------|--|

Diese Hilfsfunktion liest den Kanal **AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|cha** und setzt dann **flag** entsprechend der Leitung **line**. Ist die Leitung low, wird **flag** auf 0 gesetzt, ansonsten auf 1. Die erste Leitung eines Digitalkanals hat die Nummer 0.

4.1.21 ad_get_line_direction



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_get_line_direction (int32_t adh, int32_t cha, uint32_t *mask);</pre> |
|------------------|--|

Liefert eine Bitmaske, die die Richtung der Digitalleitung beschreibt. Jedes gesetzte Bit definiert eine Eingangsleitung, jedes gelöschte Bit eine Ausgangsleitung. Das Bit #0 legt die Richtung der ersten Leitung des Digitalports fest.

4.1.22 ad_set_line_direction



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_set_line_direction (int32_t adh, int32_t cha, int32_t mask);</pre> |
|------------------|--|

Setzt die Ein-/Ausgaberichtung aller Leitungen eines Digitalkanals **cha**. Dazu wird eine Bitmaske übergeben, die die Richtung der Leitung des Digitalkanals beschreibt. Jedes gesetzte Bit definiert eine Eingangsleitung, jedes gelöschte Bit eine Ausgangsleitung. Das Bit #0 legt die Richtung der 1. Leitung des Digitalports fest.

Beispielsweise werden mit **0xFFFF** alle Digitalleitungen auf Eingang gesetzt, mit **0x0000** auf Ausgang.

Je nach Messsystem kann eventuell nicht jede Leitung einzeln in der Richtung umgeschaltet werden oder die Richtung ist fest eingestellt (z. B. der Digitalport des USB-AD12f).

4.1.23 ad_get_version



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>uint32_t ad_get_version ();</pre> |
|------------------|--|

Liefert die Version der LIBAD4.DLL zurück. Diese ID lässt sich mit den Makros **AD_MAJOR_VERS()**, **AD_MINOR_VERS()** und **AD_BUILD_VERS()** zerlegen.

4.1.24 ad_get_drv_version



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_get_drv_version (int32_t adh, uint32_t *vers);</pre> |
|------------------|--|

Liefert die Version des Messkartentreibers zurück, auf den die **LIBAD4** aufsetzt.

5 Scanvorgang

5.1 Einführung

Neben der Einzelwertabfrage von Messwerten kann die **LIBAD4** auch einen Scanvorgang starten. Dieser tastet mehrere Eingangskanäle in einem festen Zeitraster ab und liefert die erfassten Messwerte in einem Buffer zurück.

Dabei unterscheidet die **LIBAD4** zwischen so genannten "memory-only"-Messungen und kontinuierlichen Messungen. Eine "memory-only"-Messung ist so kurz, dass die gesamten Messdaten des Scans im Hauptspeicher des PCs untergebracht werden können. Dazu wird der Scanvorgang eingestellt, gestartet und mit dem Ende des Scans liegen alle Messwerte in einem Buffer vor.

Eine kontinuierliche Messung liefert während des Scanvorgangs die erfassten Messwerte an den Aufrufer ab. Dabei kann für Messsysteme, die selbstständig einen Scanvorgang durchführen (z. B. iM-AD25a / iM-AD25 / iM3250T / iM3250, PCIe-BASE / PCI-BASEII/300/1000 mit MAD/MADDA-Modulen, USB-AD16f, USB-AD12f, meM-ADf, meM-ADfo) eine interne Messdaten-Speicherverwaltung aktiviert werden. Alternativ dazu lässt sich auch eine eigene Speicherverwaltung realisieren. Der Aufrufer ist in beiden Fällen dafür verantwortlich, die Messdaten schnell genug aus der **LIBAD4** auszulesen und zu speichern – andernfalls kommt es zu einem Überlauf der Messwerte und der Scanvorgang wird abgebrochen.

5.2 Scanparameter

Der Scanvorgang wird mit Hilfe der zwei Strukturen `struct ad_scan_desc` und `struct ad_scan_cha_desc` definiert. In `struct ad_scan_desc` werden die globalen Parameter wie Abtastzeit und Anzahl der Messwerte festgelegt. Für jeden abzutastenden Kanal ist einmal `struct ad_scan_cha_desc` auszufüllen, darin werden die kanalspezifischen Daten wie Kanalnummer oder Triggereinstellungen definiert.

5.2.1 struct ad_scan_cha_desc

Die Struktur `struct ad_scan_cha_desc` hat folgenden Aufbau:

```
C      struct ad_scan_cha_desc
      {
        int32_t cha;
        int32_t range;
        int32_t store;
        int32_t ratio;
        uint32_t zero;
        int8_t trg_mode;
        ...
        uint32_t trg_par[2];
        int32_t samples_per_run;
        ...
      };
```

Die Elemente der Struktur haben folgende Bedeutung:

- **cha**
Legt die Nummer des Kanals fest, der abgetastet und gespeichert werden soll. Diese ist Hardware abhängig und in den entsprechenden Abschnitten des Kapitels "Messsysteme" (s. S. 73) beschrieben.
- **range**
Legt den Messbereich des Kanals fest. Die Nummer des Messbereichs ist Hardware abhängig und in den entsprechenden Abschnitten des Kapitels "Messsysteme" (s. S. 73) beschrieben.
- **store**
Legt zusammen mit **ratio** (s. u.) fest, wie der Kanal gespeichert wird. Eine ausführliche Beschreibung der Speicherarten folgt im nächsten Abschnitt (s. "Speicherarten", S. 44).
- **ratio**
Legt das Speicherintervall fest (s. "Speicherarten", S. 44).
- **zero**
Legt den Nullpegel für die RMS Berechnung fest und wird deswegen auch nur benötigt, wenn der Effektivwert des Signals gespeichert wird.

- **trg_mode**
Legt zusammen mit **trg_par[]** (s. u.) fest, ob und wie dieser Kanal einen Trigger auslösen soll.
- **trg_par[]**
Legt die Triggerschwellen fest.
- **samples_per_run**
Wird von **LIBAD4** zurückgegeben und liefert die Anzahl der Messwerte, die für diesen Kanal produziert werden.



Nicht verwendete bzw. undokumentierte Elemente der Struktur müssen unbedingt auf 0 gesetzt werden!

5.2.1.1 Speicherarten

Kanäle können unterschiedlich gespeichert werden. Die Speicherart wird durch **ratio** und **store** aus der Struktur **struct ad_scan_cha_desc** festgelegt.

Im einfachsten Fall steht **store** auf **AD_STORE_DISCRETE** und **ratio** auf **1**. Dadurch wird jeder erfasste Messwert im Abtasttakt gespeichert:

| Zeit | 0ms | 2ms | 4ms | 6ms | 8ms | 10ms | 12ms | 14ms | 16ms | 18ms | 20ms | 22ms | 24ms | ... |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| Erfassung | a ₁ | a ₂ | a ₃ | a ₄ | a ₅ | a ₆ | a ₇ | a ₈ | a ₉ | a ₁₀ | a ₁₁ | a ₁₂ | a ₁₃ | ... |
| Speicherung | a ₁ | a ₂ | a ₃ | a ₄ | a ₅ | a ₆ | a ₇ | a ₈ | a ₉ | a ₁₀ | a ₁₁ | a ₁₂ | a ₁₃ | ... |

Neben dem erfassten Messwert lassen sich auch Mittelwert, Minimum, Maximum oder RMS über ein Intervall speichern. Dazu definiert die **LIBAD4** folgende Konstanten:

```
C
#define AD_STORE_DISCRETE
#define AD_STORE_AVERAGE
#define AD_STORE_MIN
#define AD_STORE_MAX
#define AD_STORE_RMS
```

Folgende Tabelle veranschaulicht den Zusammenhang zwischen dem Abtasttakt und **ratio**. In diesem Beispiel ist die Abtastzeit auf 2ms eingestellt und der Mittelwert des Kanals **a** wird im Verhältnis 1:5 gespeichert (d. h. **store** steht auf **AD_STORE_AVERAGE** und **ratio** auf 5).

| Zeit | 0ms | 2ms | 4ms | 6ms | 8ms | 10ms | 12ms | 14ms | 16ms | 18ms | 20ms | 22ms | 24ms | ... |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| Erfassung | a₁ | a₂ | a₃ | a₄ | a₅ | a₆ | a₇ | a₈ | a₉ | a₁₀ | a₁₁ | a₁₂ | a₁₃ | ... |
| Speicherung | | | | | $\frac{1}{5}\sum a_i$ | | | | | $\frac{1}{5}\sum a_i$ | | | | ... |

Es ist auch möglich, mehrere Werte eines Kanals zu speichern. Folgendes Beispiel zeigt die Speicherung des zuletzt erfassten Werts und des Mittelwerts aus 5 Messwerten (dazu wird **ratio** auf 5 und **store** auf **AD_STORE_DISCRETE** | **AD_STORE_AVERAGE** gesetzt):

| Zeit | 0ms | 2ms | 4ms | 6ms | 8ms | 10ms | 12ms | 14ms | 16ms | 18ms | 20ms | 22ms | 24ms | ... |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| Erfassung | a₁ | a₂ | a₃ | a₄ | a₅ | a₆ | a₇ | a₈ | a₉ | a₁₀ | a₁₁ | a₁₂ | a₁₃ | ... |
| Speicherung | | | | | a₅ $\frac{1}{5}\sum a_i$ | | | | | a₁₀ $\frac{1}{5}\sum a_i$ | | | | ... |

5.2.1.2 Triggerarten

Die **LIBAD4** definiert folgende Trigger:

```
C
#define AD_TRG_NONE
#define AD_TRG_POSITIVE
#define AD_TRG_NEGATIVE
#define AD_TRG_INSIDE
#define AD_TRG_OUTSIDE
#define AD_TRG_NEVER
```

Es kann für jeden einzelnen Kanal ein Trigger definiert werden. Die einzelnen Triggerbedingungen werden mit **or** verknüpft, d. h. der erste Kanal, auf dem die Triggerbedingung erfüllt ist, löst den Trigger des Messsystems aus.

Kanäle, die keinen Trigger auslösen sollen, sollten **trg_mode** auf **AD_TRG_NONE** gesetzt haben. Sind alle Kanäle einer Messung auf

AD_TRG_NONE gesetzt, wird diese ohne Trigger durchgeführt, d. h. die Messwerte werden sofort gespeichert.

Werden alle Kanäle auf **AD_TRG_NEVER** gestellt, dann wird kein Trigger ausgelöst. In diesem Fall läuft die Messung bis zum expliziten Aufruf der Funktion **ad_stop_scan()**.

Bei den Triggerbedingungen **AD_TRG_POSITIVE** (Positive Flanke) bzw. **AD_TRG_NEGATIVE** (Negative Flanke) wird ein Trigger ausgelöst bei Über- bzw. Unterschreiten des unter "Triggerpegel 1" definierten Messwerts (**struct ad_scan_cha_desc**, Parameter **trg_par[0]**). Bei Messsystemen mit 12- und 16-Bit Auflösung müssen die Werte für den 16-Bit Triggerpegel in den unteren 16-Bit des Triggerpegel Parameters eingetragen werden. Bei Flanken- triggerung, wie zum Beispiel "Positive Flanke", muss der Kanal vorher unter dem Triggerpegel sein, bevor die Überschreitung des Pegels den Trigger auslöst.

Bei den Triggerbedingungen **AD_TRG_INSIDE** bzw. **AD_TRG_OUTSIDE** wird ein Trigger ausgelöst, wenn der Messwert innerhalb bzw. außerhalb des durch "Triggerpegel 1" (**struct ad_scan_cha_desc**, Parameter **trg_par[0]** für Minimum) und "Triggerpegel 2" (**struct ad_scan_cha_desc**, Parameter **trg_par[1]** für Maximum) definierten Bereichs liegt. Bei einem Fenstertrigger ist im Unterschied zum Flankentrigger nur der aktuelle Messwert ausschlaggebend für das Auslösen des Triggers.

5.2.2 struct ad_scan_desc

Die globalen Einstellungen eines Scanvorgangs werden in der Struktur **struct ad_scan_desc** festgelegt. Diese hat folgenden Aufbau:

```

C      struct ad_scan_desc
      {
          double sample_rate;
          ...
          uint64_t prehist;
          uint64_t posthist;
          uint32_t ticks_per_run;
          uint32_t bytes_per_run;
          uint32_t samples_per_run;
          uint32_t flags;
          ...
      };

```

Die Elemente der Struktur haben folgende Bedeutung:

- **sample_rate**
Legt die Abtastrate der Messung fest (in Sekunden). Um z. B. eine Abtastrate von 100Hz zu erreichen, muss der Wert 0.01 verwendet werden.
- **prehist**
Legt die Länge der Vorgeschichte fest (nur bei Trigger, sonst auf 0 setzen).
- **posthist**
Legt die Länge der Nachgeschichte fest.
- **ticks_per_run**
Wird für kontinuierliche Messungen benötigt und legt dabei die Blockgröße fest, mit der die Messwerte von dem Messsystem abgeholt werden sollen. Anschließend gibt die LIBAD4 in **ticks_per_run** zurück, mit welcher Blockgröße im Messwertbuffer die Werte von dem Gerät geliefert werden.
- **bytes_per_run**
Wird von **LIBAD4** zurückgegeben, legt bei nicht aktivierter interner Messdaten-Speicherverwaltung die Größe des Buffers für **ad_get_next_run()** fest (in Bytes).
- **samples_per_run**
Wird von **LIBAD4** zurückgegeben, legt bei nicht aktivierter interner Messdaten-Speicherverwaltung die Anzahl der Messwerte eines Buffers fest, der von **ad_get_next_run_f()** zurückgegeben wird.

➤ **flags**

Das Bit **AD_SF_SAMPLES** in **flags** legt die Messdaten-Speicherverwaltung fest. Wenn das Bit **AD_SF_SAMPLES** gesetzt ist, wird die interne Messdaten-Speicherverwaltung aktiviert. Wenn das Bit **AD_SF_SAMPLES** nicht gesetzt ist, muss eine eigene Speicherverwaltung realisiert werden.



- **Nicht verwendete bzw. undokumentierte Elemente der Struktur müssen unbedingt auf 0 gesetzt werden!**
- **Die interne Messdaten-Speicherverwaltung kann nur für Messsysteme verwendet werden, die selbstständig die Messdaten erfassen und speichern (z. B. iM-AD25a / iM-AD25 / iM3250T / iM3250, USB-AD16f, USB-AD12f, PCIe-BASE / PCI-BASEII7300/1000 mit MAD/MADDA-Modulen, meM-ADf, meM-ADfo).**
- **Bei aktivierter interner Messdaten-Speicherverwaltung muss die Routine `ad_poll_scan_state()` kontinuierlich aufgerufen werden. Das Auslesen der Messwerte aus dem internen Speicher erfolgt mit den Routinen `ad_get_samples()`, `ad_get_samples_f()`, oder `ad_get_samples_f64()`.**

5.2.3 struct ad_scan_state

Während einer laufenden Messung liefert die **LIBAD4** den Zustand der Messung in der Struktur **struct ad_scan_state** zurück:

```
C      struct ad_scan_state
      {
          int32_t flags;
          int32_t runs_pending;
          int64_t posthist;
      };
```

Die Elemente der Struktur haben folgende Bedeutung:

- **flags**
Zeigt den Zustand der Messung an (s. u.).
- **posthist**
Enthält die aktuelle Anzahl der Messwerte nach dem Trigger. Ist kein Trigger eingestellt, dann wird die Anzahl der aktuell gesampelten Messwerte übergeben.
- **runs_pending**
Zeigt an, ob der nächste RUN ausgelesen werden kann. Ist dieses Flag ungleich null, dann kann der nächste RUN mit `ad_get_next_run ()` ausgelesen werden.

Im Element **flags** wird der Zustand des Scans übergeben. Damit lässt sich abfragen, ob der Trigger bereits erfolgt ist und ob die Messung noch läuft:

```
C      struct ad_scan_state state;
      ...
      if (state & AD_SF_TRIGGER)
          /* scan has triggered */
      ...
      if (state & AD_SF_SCANNING)
          /* scan is still running */
```

Die Struktur `struct ad_scan_state` kann von der **LIBAD4** entweder beim Auslesen der Messwerte mit `ad_get_next_run()` oder durch den expliziten Aufruf von `ad_poll_scan_state()` erfragt werden.

5.3 Memory-only Scan

Ein "memory-only"-Scan wird durch den Aufruf der drei Funktionen `ad_start_mem_scan()`, `ad_get_next_run()` und `ad_stop_scan()` ausgelöst und durchgeführt. Alle gespeicherten Samples eines solchen Scans liegen im (physikalisch vorhandenen) Hauptspeicher des PCs.

Der Beispielcode im folgenden Kapitel demonstriert das Starten eines Scans und das Auslesen der Messwerte.

5.3.1 Starten eines Scans

Um die Funktion `ad_start_mem_scan()` aufrufen zu können, müssen zuerst die abzutastenden Kanäle definiert werden. Folgendes Beispiel legt die Kanalbeschreibung für zwei Kanäle (Analogeingang 1 und Analogeingang 3) an. Beide Kanäle werden 1:1 gespeichert.



```
C
    struct ad_scan_cha_desc chav[2];
    ...
    memset (chav, 0, sizeof(chav));

    chav[0].cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|1;
    chav[0].store = AD_STORE_DISCRETE;
    chav[0].ratio = 1;
    chav[0].trg_mode = AD_TRG_NONE;

    chav[1].cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|3;
    chav[1].store = AD_STORE_DISCRETE;
    chav[1].ratio = 1;
    chav[1].trg_mode = AD_TRG_NONE;
```

Außerdem müssen die globalen Scanparameter in der Struktur `struct ad_scan_desc` gesetzt werden. Folgendes Beispiel setzt die Abtastrate auf 1kHz und speichert 500 Messwerte (pro Kanal).



```
C
    struct ad_scan_desc sd;
    ...
    memset (&sd, 0, sizeof(sd));

    sd.sample_rate = 0.001f;
    sd.prehist = 0;
    sd.posthist = 500;
```

Anschließend kann `ad_start_mem_scan()` aufgerufen werden:



```
C
    int32_t rc;
    ...
    rc = ad_start_mem_scan (adh, &sd, 2, chav);
    if (rc != 0)
        return rc;
    ...
```

Jetzt läuft der Scanvorgang im Hintergrund und ist nach 0.5sec. fertig (500x 1ms).

5.3.2 Auslesen der Messwerte

Das Auslesen der Messwerte geschieht mit der Funktion `ad_get_next_run()` oder `ad_get_next_run_f()`. Dabei liefert `ad_get_next_run()` die Messwerte direkt vom Messsystem (also als 16-Bit Werte). Die Funktion `ad_get_next_run_f()` liefert dagegen Float-Werte, die bereits (je nach Messbereich) in die zugehörigen Spannungswerte umgerechnet sind. Beide Funktionen blockieren im Fall eines "memory-only"-Scans solange, bis alle Messwerte erfasst sind (in unserem Fall also für 0.5 Sekunden).



Beide Funktionen erwarten einen Zeiger auf einen Datenbuffer. Dieser muss groß genug sein, um die gesamten Messwerte aufnehmen zu können, andernfalls wird Speicher überschrieben und das Programm wird abstürzen!

Die Mindestgröße des Buffers für `ad_get_next_run()` lässt sich am Element `bytes_per_run` der Struktur `struct ad_scan_desc` feststellen. Ein Buffer, der von `ad_get_next_run_f()` gefüllt werden soll, muss mindestens für `samples_per_run` Float-Werte Platz bieten.

In unserem Fall werden 2 Kanäle à 500 Messwerte gespeichert, so dass der Messwertespeicher eine Größe von 1000 Float-Werten aufweisen muss:



```
C
float samples[1000];
...

ASSERT (sd.samples_per_run <= 1000);

rc = ad_get_next_run_f (adh, NULL, NULL, samples);

...
```

Das Feld `samples[]` ist nach dem erfolgreichen Aufruf der Funktion mit folgenden Messwerten beschrieben (die Messwerte a_i kommen vom Analogeingang 1, die Messwerte b_i von Analogeingang 3):

| Feldindex | 0 | 1 | 2 | ... | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | ... | 998 | 999 |
|--------------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| Zeit (in ms) | 0 | 1 | 2 | ... | 498 | 499 | 0 | 1 | 2 | ... | 498 | 499 |
| Messwert | a_1 | a_2 | a_3 | ... | a_{499} | a_{500} | b_1 | b_2 | b_3 | ... | b_{499} | b_{500} |

5.3.3 Stoppen des Scans

Wenn ein Scanvorgang erfolgreich gestartet wurde (Rückgabewert von `ad_start_scan()` war 0), muss dieser Scan mit `ad_stop_scan()` abgeschlossen werden.



Der Scan muss auch dann gestoppt werden, wenn das Auslesen der Messwerte einen Fehler geliefert hat. Solange der Scan nicht gestoppt worden ist, kann kein neuer Scan gestartet werden.

Folgender Beispielcode stoppt den Scan:



```
C      int32_t scan_result;
      ...

      rc = ad_stop_scan (adh, &scan_result);

      ...
```

5.4 Kontinuierliche Messung

Neben dem "memory-only"-Scan bietet die **LIBAD4** auch die Möglichkeit, eine kontinuierliche Messung zu starten. Diese hat gegenüber dem "memory-only"-Scan die Eigenschaft, dass die Messwerte blockweise an den Aufrufer übergeben werden. Dadurch ist der Aufrufer in der Lage, die Messwerte während des Scans zu untersuchen, um z. B. eine Regelung durchzuführen.

In diesem Fall werden die Messwerte zu so genannten RUNs zusammengefasst und von der **LIBAD4** als RUNs an den Aufrufer übergeben. Die Anzahl der Messwerte, die zu einem RUN zusammengefasst werden, lässt sich durch den Aufrufer durch das Element `ticks_per_run` der Struktur `struct ad_scan_desc` vorgeben.

Dieser Parameter kann durchaus extreme Werte annehmen. Wird `ticks_per_run` beispielsweise auf 1 gesetzt, erzeugt die **LIBAD4** für jeden Messwert einen einzelnen RUN. Allerdings lassen sich mit dieser Einstellung selbstverständlich nur noch sehr niedrige Abtastraten realisieren.

Es ist die Aufgabe des Aufrufers, die Anzahl der Messwerte pro RUN so einzustellen, dass `ad_get_next_run()` noch oft genug aufgerufen werden kann, um einen Überlauf der Messwerte zu verhindern. Andernfalls wird die Messung von der **LIBAD4** abgebrochen.

5.4.1 Aufbau eines RUNs

Die Anzahl der Messwerte eines RUNs wird an die **LIBAD4** im Element `ticks_per_run` der Struktur `struct ad_scan_desc` übergeben. Folgendes Beispiel verteilt die Messwerte des Scans auf zwei RUNs à 250 Messwerte (pro Signal).

Wie dies Beispiel zeigt, wird eine kontinuierliche Abtastung mit `ad_start_scan()` (im Gegensatz zu `ad_start_mem_scan()`) gestartet. In diesem Fall muss das Feld `ticks_per_run` der Struktur `struct ad_scan_desc` vorher definiert werden.

Das Beispiel produziert die folgenden zwei RUNs während der Messung, wobei der erste RUN 250ms nach Start des Scans, der zweite 500ms nach Start des Scans von `ad_get_next_run()` zurückgegeben wird.



```

C      int32_t rc;
        struct ad_scan_cha_desc chav[2];
        struct ad_

        scan_desc sd;

        ...

        memset (&chav, 0, sizeof(chav));
        memset (&sd, 0, sizeof(sd));

        chav[0].cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|1;
        chav[0].store = AD_STORE_DISCRETE;
        chav[0].ratio = 1;
        chav[0].trg_mode = AD_TRG_NONE;

        chav[1].cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|3;
        chav[1].store = AD_STORE_DISCRETE;
        chav[1].ratio = 1;
        chav[1].trg_mode = AD_TRG_NONE;

        sd.sample_rate = 0.001f;
        sd.prehist = 0;
        sd.posthist = 500;
        sd.ticks_per_run = 250;

        rc = ad_start_scan (adh, &sd, 2, chav);
        if (rc != 0)
            return rc;
        ...

        rc = ad_stop_scan (adh, &scan_result);
        ...

```

| Feldindex | 0 | 1 | 2 | ... | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ... | 98 | 99 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------------------------|------------------------|
| Zeit (in ms) | 0 | 1 | 2 | ... | 248 | 249 | 0 | 1 | 2 | ... | 248 | 249 |
| Messwert | a₁ | a₂ | a₃ | ... | a₂₄₉ | a₂₅₀ | b₁ | b₂ | b₃ | ... | b₂₄₉ | b₂₅₀ |

RUN #0

| Feldindex | 0 | 1 | 2 | ... | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | ... | 498 | 499 |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|------------------------|------------------------|
| Zeit (in ms) | 250 | 251 | 252 | ... | 498 | 499 | 250 | 251 | 252 | ... | 498 | 499 |
| Messwert | a₂₅₁ | a₂₅₂ | a₂₅₃ | ... | a₄₉₉ | a₅₀₀ | b₂₅₁ | b₂₅₂ | b₂₅₃ | ... | b₄₉₉ | b₅₀₀ |

RUN #1

Folgender Beispielcode liest die RUNs während der Messung aus:



```

C
struct ad_scan_state state;
uint8_t *data, *p;
uint32_t samples, runs, run_id;
int32_t rc;
...

/* alloc enough space to hold all those runs */
samples = sd.prehist + sd.posthist;
runs = (samples + sd.ticks_per_run-1) / sd.ticks_per_run;
data = malloc (runs * sd.bytes_per_run);
if (data == NULL)
    /* error handling ... */

p = data;
state.flags = AD_SF_SCANNING;

while (state.flags & AD_SF_SCANNING)
{
    rc = ad_get_next_run (adh, &state, &run_id, p);
    if (rc != 0)
        /* error handling ... */

    printf ("got run %d (%d pending)\n",
            run_id, state.runs_pending);

    p += sd.bytes_per_run;
}

rc = ad_stop_scan (adh, &scan_result);
...

```

5.4.2 Ein Messwert pro RUN

Wird `ticks_per_run` auf 1 gestellt, dann werden RUNs mit einem Messwert pro Signal erzeugt:



```

C      struct ad_scan_cha_desc chav[2];
          struct ad_scan_desc sd;
          int32_t rc;

          ...

          memset (&chav, 0, sizeof(chav));
          memset (&sd, 0, sizeof(sd));

          chav[0].cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|1;
          chav[0].store = AD_STORE_DISCRETE;
          chav[0].ratio = 1;
          chav[0].trg_mode = AD_TRG_NONE;

          chav[1].cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|3;
          chav[1].store = AD_STORE_DISCRETE;
          chav[1].ratio = 1;
          chav[1].trg_mode = AD_TRG_NONE;

          sd.sample_rate = 0.010f;
          sd.prehist = 0;
          sd.posthist = 500;
          sd.ticks_per_run = 1;

          rc = ad_start_scan (adh, &sd, 2, chav);
          if (rc != 0)
              return rc;

          ...

```

Das obige Beispiel erzeugt 500 RUNs mit folgendem Aufbau:

| Feldindex | 0 | 1 |
|-----------|-------|-------|
| Zeit | 0 | 0 |
| Messwert | a_1 | b_1 |

RUN #0

| Feldindex | 0 | 1 |
|-----------|-------|-------|
| Zeit | 10 | 10 |
| Messwert | a_2 | b_2 |

RUN #1

| Feldindex | 0 | 1 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| Zeit | 4980 | 4980 |
| Messwert | a₄₉₉ | b₄₉₉ |

RUN #498

| Feldindex | 0 | 1 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| Zeit | 4990 | 4990 |
| Messwert | a₅₀₀ | b₅₀₀ |

RUN #499

5.4.3 Signale mit unterschiedlicher Speicherrate

Die beiden vorherigen Beispiele (s. "Ein Messwert pro RUN", S. 56) beschreiben den Aufbau eines RUNs für Signale, die im Verhältnis 1:1 gespeichert werden. Im Folgenden wird ein Beispiel mit der Speicherrate 1:5 erläutert.

Wird ein Signal in einem anderen Verhältnis als 1:1 gespeichert, dann muss zwischen Abtasttakt und Speicherrate unterschieden werden. Die Abtastrate wird für alle Kanäle des Messsystems durch das Element **sample_rate** der Struktur **struct ad_scan_desc** festgelegt. Die Speicherrate kann für jeden Kanal unterschiedlich sein und ergibt sich über den Parameter **ratio** der Struktur **struct ad_scan_desc**, indem die Speicherrate durch **ratio** geteilt wird.

Folgendes Diagramm stellt einen Scan dar, in dem zwei Eingangskanäle mit einer Abtastrate von 2ms (50Hz) abgetastet werden. Der Eingang **a** wird 1:1 gespeichert, der Eingang **b** speichert den Mittelwert über 5 Messwerte.

| Zeit (in ms) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ... |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| Messwert Kanal a | a₁ | a₂ | a₃ | a₄ | a₅ | a₆ | a₇ | a₈ | a₉ | a₁₀ | a₁₁ | a₁₂ | a₁₃ | ... |
| Messwert Kanal b | b₁ | b₂ | b₃ | b₄ | b₅ | b₆ | b₇ | b₈ | b₉ | b₁₀ | b₁₁ | b₁₂ | b₁₃ | ... |
| Speicherwert Kanal a | a₁ | a₂ | a₃ | a₄ | a₅ | a₆ | a₇ | a₈ | a₉ | a₁₀ | a₁₁ | a₁₂ | a₁₃ | ... |
| Speicherwert Kanal b | | | | | $\frac{1}{5} \sum b_i$ | | | | | $\frac{1}{5} \sum b_i$ | | | | ... |

Nachdem in jedem RUN mindestens ein Messwert pro Kanal gespeichert wird, legen die eingestellten Speicherraten die minimale Größe eines RUNs fest.

In diesem Fall besteht der kleinste mögliche RUN aus fünf Abtasttakten (**ticks_per_run** = 5), in dem fünf Messwerte des Eingangskanals **a** enthalten sind, sowie der Mittelwert aus den fünf Messwerten des Eingangs **b**:

| Feldindex | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Zeit (in ms) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Kanal a | a_1 | a_2 | a_3 | a_4 | a_5 |
| Kanal b | | | | | $\frac{1}{5} \sum b_i$ |

Werden mehrere Abtasttakte zu einem RUN kombiniert, liegen die gespeicherten Werte pro Signal hintereinander (Beispiel für **ticks_per_run** = 250):

| Feldindex | 0 | 1 | 2 | ... | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | ... | 398 | 399 |
|--------------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|------------------------|------------------------|
| Zeit (in ms) | 0 | 2 | 4 | ... | 496 | 498 | 8 | 18 | 28 | ... | 488 | 498 |
| Werte | a_1 | a_2 | a_3 | ... | a_{249} | a_{250} | $\frac{1}{5} \sum b_i$ | $\frac{1}{5} \sum b_i$ | $\frac{1}{5} \sum b_i$ | ... | $\frac{1}{5} \sum b_i$ | $\frac{1}{5} \sum b_i$ |

5.5 Messung mit Triggerung

Mit der **LIBAD4** kann eine Messung mit Triggerung erfolgen. Dabei muss die interne Messdaten-Speicherverwaltung aktiviert sein (Bit **AD_SF_SAMPLES** des Elements **flags** in der **struct ad_scan_desc** ist gesetzt).

Die Anzahl der Messwerte vor der Triggerung (Vorgeschichte bzw. Prehistory) und die Anzahl der Messwerte nach der Triggerung (Nachgeschichte bzw. Posthistory) können für die Messung in der Struktur **struct ad_scan_desc** frei eingestellt werden.

Ferner lässt sich für jeden Kanal eine Triggerbedingung in der Scankanalstruktur **struct ad_scan_cha_desc** definieren. Trifft eine der Triggerbedingungen zu, erfolgt die Triggerung und die Messung wird nach Ablauf der Nachgeschichte beendet.

Das kontinuierliche Lesen der Messwerte erfolgt mit dem Befehl **ad_poll_scan_state()**. Dabei wird auch der aktuelle Scanzustand abgefragt. Solange das Bit **AD_SF_SCANNING** im Element **flags** der Struktur **struct ad_scan_state** gesetzt ist, läuft die Messung. Sobald das Bit **AD_SF_TRIGGER** gesetzt ist, hat die Messung getriggert, d. h. wenigstens eine der Triggerbedingungen wurde erreicht.

Das Auslesen der Messwerte erfolgt mit den Routinen **ad_get_samples()**, **ad_get_samples_f()**, oder **ad_get_samples_f64()**. Dabei liefert **ad_get_samples()** die Messwerte direkt vom Messsystem, **ad_get_samples_f()** oder **ad_get_samples_f64()** liefern dagegen Float-Werte bzw. Double-Werte, die bereits (je nach Messbereich) in die zugehörigen Spannungswerte umgerechnet sind. Bei diesen Routinen können Daten gezielt für einen Scankanal ausgelesen werden. Anzahl und Startposition der auszulesenden Daten werden beim Funktionsaufruf übergeben. Informationen über den Messdatenspeicher für einen Messkanal werden mittels **ad_get_sample_layout()** abgefragt.



Die Installation des Libad4 SDK unter Windows® beinhaltet ein C/C++-Beispiel für die Programmierung eines Scans mit Triggerung.

5.6 Funktionsbeschreibung (Scan)

5.6.1 ad_start_mem_scan



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_start_mem_scan (int32_t adh, struct ad_scan_desc *scan_desc, uint32_t chac, struct ad_scan_cha_desc *chav);</pre> |
|------------------|--|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>struct ad_scan_cha_desc chav[2]; struct ad_scan_desc sd; int32_t rc; ... memset (&chav, 0, sizeof(chav)); memset (&sd, 0, sizeof(sd)); /* sample and store analog input #1 */ chav[0].cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN 1; chav[0].store = AD_STORE_DISCRETE; chav[0].ratio = 1; chav[0].trg_mode = AD_TRG_NONE; /* sample and store analog input #3 */ chav[1].cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN 3; chav[1].store = AD_STORE_DISCRETE; chav[1].ratio = 1; chav[1].trg_mode = AD_TRG_NONE; /* 1kHz, 500 samples per signal / sd.sample_rate = 0.001f; sd.prehist = 0; sd.posthist = 500; rc = ad_start_mem_scan (adh, &sd, 2, chav); if (rc != 0) /* error handling */</pre> |
|----------|--|

Startet einen "memory-only"-Scan. Der Funktion werden ein Zeiger auf ein Element der Struktur **struct ad_scan_desc** übergeben, die Zahl der abzu-

tastenden Kanäle und ein Feld von Elementen der Struktur **struct ad_scan_cha_desc**.



**Aufgrund von Einschränkungen bei den meisten Messkarten müssen die Eingangskanäle unbedingt in aufsteigender Reihenfolge im Feld `chav[]` angegeben werden! Werden außer Analogeingängen auch Zähler und Digital-
eingänge abgetastet, müssen erst alle analogen, dann alle Zähler und schließlich die digitalen Kanäle angegeben werden!**

Die Felder `sample_rate`, `ticks_per_run`, `bytes_per_run` und `samples_per_run` der Struktur **struct ad_scan_desc** werden für die angegebenen Parameter neu berechnet (s. "`ad_calc_run_size`", S. 67).

5.6.2 ad_start_scan



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_start_scan (int32_t adh, struct ad_scan_desc *scan_desc, uint32_t chac, struct ad_scan_cha_desc *chav);</pre> |
|------------------|--|

Anders als `ad_start_mem_scan()` wertet `ad_start_scan()` das Element `ticks_per_run` der Struktur **struct ad_scan_desc** aus. Damit kann ein Scan auf mehrere RUNs verteilt werden (s. "Kontinuierliche Messung", S. 54).



Aufgrund von Einschränkungen bei den meisten Messkarten müssen die Eingangskanäle unbedingt in aufsteigender Reihenfolge im Feld `chav[]` angegeben werden! Werden außer Analogeingängen auch Zähler und Digital-
eingänge abgetastet, müssen erst alle analogen, dann alle Zähler und schließlich die digitalen Kanäle angegeben werden!

Die Felder `sample_rate`, `ticks_per_run`, `bytes_per_run` und `samples_per_run` der Struktur `struct ad_scan_desc` werden für die angegebenen Parameter neu berechnet (s. "`ad_calc_run_size`", S. 67).

5.6.3 ad_get_sample_layout



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_get_sample_layout (int32_t adh, int32_t index, struct ad_sample_layout *layout);</pre> |
|------------------|--|

Liefert bei aktivierter interner Messdaten-Speicherverwaltung Informationen über den Messdatenspeicher für den Scankanal `index`. Die Scankanal Nummerierung beginnt mit `index = 0`.

Die Struktur `struct ad_sample_layout` besteht aus:

| | |
|----------|---|
| C | <pre>struct ad_sample_layout { uint64_t buffer_start; uint64_t start; uint64_t prehist_samples; uint64_t posthist_samples; };</pre> |
|----------|---|

Die Elemente der Struktur haben folgende Bedeutung:

- **buffer_start**
Position des ersten Messwerts im Messdatenspeicher des Scans
- **start**
Position des ersten Messwerts der Vorgeschichte im Messdatenspeicher
- **prehist_samples**
Anzahl der vorhandenen Messwerte vor der Triggerung im Messdatenspeicher. Die Vorgeschichte erstreckt sich von der Position **start** bis zu (**start** + **prehist_samples**).
- **posthist_samples**
Anzahl der vorhandenen Messwerte nach der Triggerung. Die Nachgeschichte erstreckt sich von der Position (**start** + **prehist_samples**) bis zu (**start** + **prehist_samples** + **posthist_samples**).



Die interne Messdaten-Speicherverwaltung (Bit **AD_SF_SAMPLES** des Elements **flags** in der struct **ad_scan_desc** gesetzt) muss aktiviert sein, damit diese Routine benutzt werden kann.

5.6.4 ad_get_samples



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_get_samples (int32_t adh, int32_t index, int32_t type, uint64_t offset, uint32_t *n, void *buf);</pre> |
|------------------|--|

Liefert bei aktivierter interner Messdaten-Speicherverwaltung die direkt vom Messsystem gelieferten Messwerte für den Scankanal **index**. Die Scankanal Nummerierung beginnt mit **index** = 0.

Je nach Speichertiefe des Messkanals werden vom Messsystem 16-Bit bzw. 32-Bit Messwerte geliefert. Ab der Position **offset** werden **n** Messwerte aus dem

Messdatenspeicher des Scankanals **index** gelesen. Die Position **offset** kann nicht kleiner sein als **buffer_start**, das Element der Struktur **struct ad_get_sample_layout**.

Die wirkliche Anzahl gelesener Messwerte wird in dem Parameter **n** zurück geliefert. Der Parameter **type** entscheidet, welche Daten aus dem Datenspeicher in dem zur Verfügung gestellten Bereich **buf** geschrieben werden. Es können nur die Datentypen (Discrete, Minimum, Maximum, etc) extrahiert werden, die bei dem Speichermodus (Element **store** in **struct ad_scan_cha_desc**) des Scankanals definiert waren.



- Die Funktion erwartet einen Zeiger auf einen Datenbuffer. Dieser muss groß genug sein, um die gesamten Messwerte aufnehmen zu können. Andernfalls wird Speicher überschrieben und das Programm wird abstürzen!
- Die interne Messdaten-Speicherverwaltung (Bit **AD_SF_SAMPLES** des Elements **flags** in der **struct ad_scan_desc** gesetzt) muss aktiviert sein, damit diese Routine benutzt werden kann.

5.6.5 ad_get_samples_f



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_get_samples_f (int32_t adh, int32_t index, int32_t type, uint64_t offset, uint32_t *n, float *buf);</pre> |
|------------------|---|

Liefert bei aktivierter interner Messdaten-Speicherverwaltung die Messwerte als Float- bzw. Double-Werte für den Scankanal **index**. Die Scankanal Nummerierung beginnt mit **index = 0**.

Die vom Messsystem gelieferten Messwerte wurden je nach eingestelltem Messbereich in die zugehörigen Spannungswerte umgerechnet. Ab der Position **offset** werden **n** Messwerte im Float-Format aus dem Messdatenspeicher des

Scankanals **index** gelesen. Die Position **offset** kann nicht kleiner sein als **buffer_start**, das Element der Struktur **struct ad_get_sample_layout**.

Die wirkliche Anzahl gelesener Messwerte wird in dem Parameter **n** zurück geliefert. Der Parameter **type** entscheidet, welche Daten aus dem Datenspeicher in dem zur Verfügung gestellten Bereich **buf** geschrieben werden. Es können nur die Datentypen (Discrete, Minimum, Maximum, etc) extrahiert werden, die bei dem Speichermodus (Element **store** in **struct ad_scan_cha_desc**) des Scankanals definiert waren.



- Die Funktion erwartet einen Zeiger auf einen Datenbuffer. Dieser muss groß genug sein, um die gesamten Messwerte aufnehmen zu können. Andernfalls wird Speicher überschrieben und das Programm wird abstürzen!
 - Die interne Messdaten-Speicherverwaltung (Bit **AD_SF_SAMPLES** des Elements **flags** in der **struct ad_scan_desc** gesetzt) muss aktiviert sein, damit diese Routine benutzt werden kann.
 - Werden Messkanäle mit einer Speichertiefe von mehr als 16 Bit verwendet (z. B. 32-Bit Zähler der PCIe-BASE / PCI-BASEII / PCI-PIO), sollte die Routine **ad_get_samples_f64()** benutzt werden.
-

5.6.6 ad_get_samples_f64



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_get_samples_f64 (int32_t adh, int32_t index, int32_t type, uint64_t offset, uint32_t *n, double *buf);</pre> |
|------------------|--|

Liefert bei aktivierter interner Messdaten-Speicherverwaltung die Messwerte als Float- bzw. Double-Werte für den Scankanal **index**. Die Scankanal Nummerierung beginnt mit **index = 0**.

Die vom Messsystem gelieferten Messwerte wurden je nach eingestelltem Messbereich in die zugehörigen Spannungswerte umgerechnet. Ab der Position **offset** werden **n** Messwerte im Float-Format aus dem Messdatenspeicher des Scankanals **index** gelesen. Die Position **offset** kann nicht kleiner sein als **buffer_start**, das Element der Struktur **struct ad_get_sample_layout**.

Die wirkliche Anzahl gelesener Messwerte wird in dem Parameter **n** zurück geliefert. Der Parameter **type** entscheidet, welche Daten aus dem Datenspeicher in dem zur Verfügung gestellten Bereich **buf** geschrieben werden. Es können nur die Datentypen (Discrete, Minimum, Maximum, etc) extrahiert werden, die bei dem Speichermodus (Element **store** in **struct ad_scan_cha_desc**) des Scankanals definiert waren.



- Die Funktion erwartet einen Zeiger auf einen Datenbuffer. Dieser muss groß genug sein, um die gesamten Messwerte aufnehmen zu können. Andernfalls wird Speicher überschrieben und das Programm wird abstürzen!
 - Die interne Messdaten-Speicherverwaltung (Bit **AD_SF_SAMPLES** des Elements **flags** in der **struct ad_scan_desc** gesetzt) muss aktiviert sein, damit diese Routine benutzt werden kann.
-
-

5.6.7 ad_calc_run_size



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_calc_run_size (int32_t adh, struct ad_scan_desc *scan_desc, uint32_t chac, struct ad_scan_cha_desc *chav);</pre> |
|------------------|---|

Berechnet die Felder `sample_rate`, `ticks_per_run`, `bytes_per_run` und `samples_per_run` der Struktur `struct ad_scan_desc` für die angegebenen Parameter.

Die Felder werden wie bei einem Aufruf der Funktion `ad_start_scan()` berechnet, allerdings ohne den Scanvorgang auszulösen. Wie durch `ad_start_scan()` erfolgt die Berechnung bzw. Anpassung folgendermaßen:

➤ **sample_rate**

Wird auf die tatsächlich mögliche Abtastzeit gestellt (die meisten Messkarten können die Abtastzeit nur in festen Schritten einstellen).

➤ **ticks_per_run**

Wird so angepasst, dass mindestens ein Wert jedes Signals gespeichert wird und/oder ein einzelner RUN in den internen Speicher des Treibers passt.

➤ **bytes_per_run**

Wird von **LIBAD4** berechnet und gibt für `ad_get_next_run()` die Anzahl der Bytes des Buffers vor.

➤ **samples_per_run**

Wird von **LIBAD4** berechnet und gibt für `ad_get_next_run_f()` die Anzahl der Floatwerte innerhalb eines Buffers vor.

Aus `samples_per_run` lässt sich die Größe des Buffers für `ad_get_next_run_f()` berechnen:



```
C
struct ad_scan_desc sd;
float *data;
int32_t rc;
...

rc = ad_calc_run_size (adh, &sd, 2, chav);
if (rc != 0)
    return rc;

data = malloc (sd.samples_per_run * sizeof(float));
...
```

5.6.8 ad_get_next_run



| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_get_next_run (int32_t adh, struct ad_scan_state *state, uint32_t *run, void *p);</pre> |
|------------------|--|

Liefert die Messwerte eines Scans.

Die Funktion `ad_get_next_run()` liefert die Messwerte direkt vom Messsystem (also als 16-Bit oder 32-Bit Werte, je nach Speichertiefe des Messkanals). Die untere Messbereichsgrenze entspricht dem Wert `0x0000`, die obere Messbereichsgrenze dem Wert `0xffff` bzw. `0xffffffff` (genauer gesagt entspricht die obere Grenze dem Wert `0x10000` bzw. `0x100000000`, der nicht erreicht wird).



Die Messwerte werden in "network byte order" geliefert, sind also nicht in der byte order einer x86 CPU!

Die Funktion blockiert solange, bis die Messwerte eines RUNs eingetroffen sind. Dies bedeutet, dass die Funktion bei einem "memory-only"-Scan bis zum Ende der Messung blockiert (da ein "memory-only"-Scan alle Messwerte in einem RUN speichert).

5.6.9 ad_get_next_run_f



```
Prototype  int32_t
           ad_get_next_run_f (int32_t adh,
                             struct ad_scan_state *state,
                             uint32_t *run, float *p);
```

Liefert die Messwerte eines Scans als Float-Werte.

Die vom Messsystem gelieferten Messwerte werden je nach Messbereich in die zugehörigen Spannungswerte umgerechnet.

Die Funktion blockiert solange, bis die Messwerte eines RUNs eingetroffen sind. Dies bedeutet, dass die Funktion bei einem "memory-only"-Scan bis zum Ende der Messung blockiert (da ein "memory-only"-Scan alle Messwerte in einem RUN speichert).



Werden Messkanäle mit einer Speichertiefe von mehr als 16 Bit verwendet (z. B. 32-Bit Zähler der PCIe-BASE / PCI-BASEII / PCI-PIO), sollte die Routine `ad_get_next_run_f64()` benutzt werden.

5.6.10 ad_get_next_run_f64



```
Prototype  int32_t
           ad_get_next_run_f64 (int32_t adh,
                                struct ad_scan_state *state,
                                uint32_t *run, double *p);
```

Liefert die Messwerte eines Scans als Float-Werte.

Die vom Messsystem gelieferten Messwerte werden je nach Messbereich in die zugehörigen Spannungswerte umgerechnet.

Die Funktion blockiert solange, bis die Messwerte eines RUNs eingetroffen sind. Dies bedeutet, dass die Funktion bei einem "memory-only"-Scan bis zum Ende der Messung blockiert (da ein "memory-only"-Scan alle Messwerte in einem RUN speichert).

5.6.11 ad_poll_scan_state



| | |
|------------------|---|
| Prototype | <pre>int32_t ad_poll_scan_state (int32_t adh, struct ad_scan_state *state);</pre> |
|------------------|---|

Liefert den aktuellen Zustand der Messung wie ein Aufruf der Funktion **ad_get_next_run()**. Im Gegensatz zu **ad_get_next_run()** blockiert die Funktion nicht.



Bei aktivierter interner Messdaten-Speicherverwaltung (Bit `AD_SF_SAMPLES` des Elements `flags` in der `struct ad_scan_desc` gesetzt) muss die Routine `ad_poll_scan_state()` kontinuierlich aufgerufen werden.

5.6.12 ad_stop_scan



```
Prototype  int32_t  
           ad_stop_scan (int32_t adh, int32_t *scan_result);
```

Beendet den Scan. In **scan_result** wird das Ergebnis des Scans übergeben (z. B. eine Fehlernummer, wenn der Scan wegen Überlauf abgebrochen wurde).



Wenn ein Scanvorgang erfolgreich gestartet wurde (Rückgabewert von `ad_start_scan()` war 0), muss dieser Scan mit `ad_stop_scan ()` abgeschlossen werden.

6 Messsysteme

6.1 Hinweise

Ein- bzw. Ausgangskanäle werden in **LIBAD4** durch Kanalnummern spezifiziert. Die Kanalnummer (32-Bit Integer) legt auch die Kanalart fest. Die Kanalart unterscheidet zwischen Analogeingang, Analogausgang und Digitalkanal. Diese Codierung ist im obersten Byte der Kanalnummer vorhanden und muss per "oder"-Operator (|) mit der Kanalnummer verknüpft werden.

Folgende Kanalarten sind in **LIBAD4** definiert:

```
C      #define AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN
      #define AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT
      #define AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO
      #define AD_CHA_TYPE_COUNTER
```

Die Kanalnummern sind abhängig vom eingesetzten Messsystem und in den entsprechenden Kapiteln dokumentiert. Der erste Analogeingang eines USB-AD12f lässt sich z. B. angeben durch den Ausdruck `AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN | 1`.

Analoge Kanäle erwarten neben der Kanalnummer noch die Angabe eines Messbereichs (bzw. Ausgangsbereichs), in dem gemessen (bzw. ausgegeben) werden soll. Dieser Messbereich ist wie die Kanalnummer vom Messsystem abhängig und in den folgenden Kapiteln dokumentiert.

6.2 iM-AD25a / iM-AD25 / iM3250T / iM3250



Um ein iM-AD25a, iM-AD25, iM3250T oder iM2350 mit der **LIBAD4** zu öffnen, muss an `ad_open()` der String `"im:<ip-addr>"` übergeben werden. Dabei muss `<ip-addr>` durch die entsprechende IP-Adresse ersetzt werden. Der String `"im:192.168.1.1"` öffnet z. B. das iM-Gerät mit der IP Adresse 192.168.1.1. Beim Öffnen in der **LIBAD4** wird nicht zwischen den iM-Gerätetypen unterschieden.

| Messsystem | Analog | Kanalnummer | Messbereich | range | Digital |
|-----------------|-------------|---|-----------------------------|--------|--------------------------|
| iM-AD25a | 16 Eingänge | 1..16 | $\pm 10.24V$ $\pm 5.12V$ | 1 0 | 1: Ausgang (Bit 0..3) |
| iM-AD25 | 16 Eingänge | 1..16 | $\pm 5.12V$ | 0 | 1: Ausgang (Bit 0..3) |
| iM3250T | 32 Eingänge | 17..48 | $\pm 5.12V$ | 0 | - |
| iM3250 | 32 Eingänge | AnIn 1..16: 1..16 (bei 1 BPL) 17..32 (bei 2 BPL) AnIn 17..32: 33..48 | $\pm 5.00V$ | 0 | - |



Bitte beachten Sie, dass sich beim iM3250T durch einen gesteckten MAL-Messverstärker der Messbereich des entsprechenden Kanals verändern kann.

6.2.1 Kanalnummern iM-AD25a / iM-AD25

Der erste analoge Eingangskanal eines iM-AD25a / iM-AD25 beginnt bei 1. Damit ergeben sich für die 16 Analogeingänge folgende Konstanten:

```
C      #define AI1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0001)
      #define AI2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0002)
      ...
      #define AI16   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0010)
```

Das iM-AD25a / iM-AD25 verfügt außerdem über einen Digitalausgang mit 4 Leitungen. Dessen Richtung ist nicht umschaltbar.

```
C      #define DOUT   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0001)
```

6.2.2 Kanalnummern iM3250T

Der erste analoge Eingangskanal eines iM3250T beginnt bei 17. Damit ergeben sich für die 32 analogen Eingänge folgende Konstanten:

```
C      #define AI1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0011)
      #define AI2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0012)
      ...
      #define AI32   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0030)
```

6.2.3 Kanalnummern iM3250

Die Kanalnummern des iM3250 hängen von der Ausbaustufe des Geräts ab. Ist nur eine BPL im Gerät vorhanden, erscheinen die ersten 16 Kanäle von 1 bis 16. Falls beide BPLs eingebaut sind, erscheinen die ersten 16 Kanäle von 17 bis 32. Die zweiten 16 Eingänge sind immer unter den Nummern 33 bis 48 erreichbar.

```

C      #ifndef BPL1      /* 1 bpl installed /

      #define AI1      (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0001)
      #define AI2      (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0002)
      ...
      #define AI16     (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0010)

      #else              /* 2 bpl's installed /

      #define AI1      (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0011)
      #define AI2      (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0012)
      ...
      #define AI16     (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0020)

      #endif /* BPL1 */

      #define AI17     (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0021)
      #define AI18     (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0022)
      ...
      #define AI32     (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0030)

```

6.3 LAN-AD16f



Um ein LAN-Messsystem vom Typ LAN-AD16f mit der **LIBAD4** zu öffnen, wird an `ad_open()` der String "`lanbase:<ip-addr>`" oder "`lanbase:@<sn>`" übergeben. Dabei muss `<ip-addr>` durch die entsprechende IP-Adresse ersetzt werden oder `<sn>` durch die Seriennummer des LAN-AD16f. Der String "`lanbase:192.168.1.1`" öffnet z. B. das LAN-Gerät mit der IP Adresse 192.168.1.1 und der String "`lanbase:@157`" öffnet das LAN-Gerät mit der Seriennummer 157.

| Messsystem | Analog | Kanalnummer | range (Messber.) | range (Ausgabebereich) | Digital | Richtung |
|------------------|---------------------------|-----------------|---|------------------------|------------------------|--|
| LAN-AD16f | 16 Eingänge 2 Ausgänge | 1..16 1 .. 2 | 0 ($\pm 1.024V$) 1 ($\pm 2.048V$) 2 ($\pm 5.120V$) 3 ($\pm 10.240V$) | 0 ($\pm 10.24V$) | 2 Ports (je 16 Bit) | 1: Eingang (Bit 0..15) 2: Ausg. (Bit 0..15) |

6.3.1 Kanalnummern LAN-AD16f

Die 16 Analogeingänge eines LAN-AD16f besitzen die Kanalnummern 1-16. Die beiden Analogausgänge haben die Kanalnummern 1 und 2.

Damit ergeben sich für die 16 Analogeingänge folgende Konstanten:

```
C
#define AI1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0001)
#define AI2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0002)
...
#define AI16   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0010)
```

Die beiden analogen Ausgangskanäle eines LAN-AD16f erhalten die folgenden Konstanten:

| | |
|----------|--|
| C | <pre>#define AO1 (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 0x0001) #define AO2 (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 0x0002)</pre> |
|----------|--|

Das LAN-AD16f stellt zwei 16-Bit Digitalports zur Verfügung. Die Richtung der digitalen Portleitungen ist nicht umschaltbar. Dabei stehen die 16 Leitungen des ersten Ports (DIO1) auf Eingang, die 16 Leitungen des zweiten Ports (DIO2) auf Ausgang.

Für die Kanäle ergeben sich folgende Konstanten:

| | |
|----------|--|
| C | <pre>#define DIO1 (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO 0x0001) #define DIO2 (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO 0x0002)</pre> |
|----------|--|

Außerdem besitzt das LAN-AD16f einen Zählereingang. Dieser kann in verschiedenen Betriebsarten verwendet werden und muss vor der Verwendung per Software konfiguriert werden (siehe "Konfiguration des Zähler", S. 79). Die Eingänge des Zählers (Signal A, Signal B, Reset) werden mit den ersten drei Digitaleingangsleitungen des LAN-AD16f verbunden.

Für den 19-Bit Zählereingang ergibt sich die folgende Konstante:

| | |
|----------|---|
| C | <pre>#define CNT1 (AD_CHA_TYPE_COUNTER 0x0001)</pre> |
|----------|---|

6.3.2 Konfiguration des Zählers

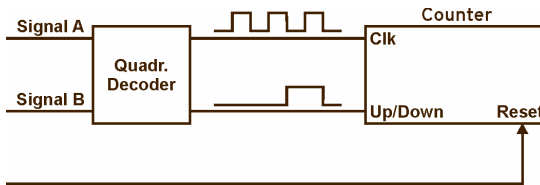


Abbildung 7

Zur Einstellung des Zählers werden die Konfigurationsparameter in die Struktur `ad_counter_mode` eingetragen und an `ad_ioctl()` übergeben.

Das folgende Beispiel zeigt das prinzipielle Vorgehen: Es konfiguriert den Zähler des LAN-AD16f mit der Seriennummer 157 in der Betriebsart "Zähler".

| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_ioctl (int32_t adh, int32_t ioc, void *par, int32_t size);</pre> |
|------------------|--|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>#include "libad.h" ... struct ad_counter_mode par; int32_t adh; int32_t st; ... adh = ad_open ("lanbase:@157"); memset (&par, 0, sizeof(par)); par.cha = AD_CHA_TYPE_COUNTER 1; par.mode = AD_CNT_COUNTER; st = ad_ioctl (adh, AD_SET_COUNTER_MODE, &par, sizeof(par)); ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|--|

Die Struktur `ad_counter_mode` hat folgenden Aufbau:

```

C      struct ad_counter_mode
          {
            uint32_t cha;

            uint8_t mode;
            uint8_t mux_a;
            uint8_t mux_b;
            uint8_t mux_rst;
            uint16_t flags;
            ...
          };
    
```

Die Elemente der Struktur haben folgende Bedeutung:

- **cha**
Legt den Zählerkanal fest, der konfiguriert werden soll. Dieser muss beim LAN-AD16f immer den Wert "1" haben.
- **mode**
Legt die Betriebsart des Zählers fest.

| Betriebsart | Beschreibung |
|----------------------------|--|
| AD_CNT_COUNTER | Der Zählerkanal arbeitet als einfacher Zähler. Es wird nur der Eingang A des Zähler verwendet, wobei jede positive Flanke am Eingang den Zählerstand um eins erhöht. |
| AD_CNT_UPDOWN | Der Zählerkanal arbeitet als Up/Down Zähler, also mit umschaltbarer Zählrichtung. Dabei arbeitet der Eingang A des Zählers als Takteingang, der Eingang B übernimmt die Richtungsumschaltung. Steht der Eingang B des Zähler auf low, dann erhöht jede positive Flanke am Eingang A den Zählerstand um eins. Ansonsten erniedrigt die positive Flanke den Zählerstand. |
| AD_CNT_QUAD_DECODER | Der Zähler decodiert an den Eingängen A und B die zwei Spuren eines Inkrementalgebers. Dabei wird jede Flanke der beiden Spuren dekodiert. |

➤ **mux_a, mux_b, mux_rst**

Legt die Pins der beiden Digitalports fest, die mit den jeweiligen Eingängen des Zählers verbunden sind. Dieses Element wird beim LAN-AD16f ignoriert, da der Anschluss der Zählereingänge fest eingestellt ist.

➤ **flags**

Legt die Arbeitsweise der Zählereingänge fest. Die Arbeitsweisen können mit **OR** verknüpft werden, z. B. **AD_CNT_INV_RST|AD_CNT_ENABLE_RST**.

| Arbeitsweise | Beschreibung |
|--------------------------|--------------------------------------|
| AD_CNT_INV_A | Zählereingang A reagiert invertiert. |
| AD_CNT_INV_B | Zählereingang B reagiert invertiert. |
| AD_CNT_INV_RST | Reseteingang reagiert invertiert. |
| AD_CNT_ENABLE_RST | Reseteingang ist aktiviert. |

6.4 PCIe-BASE / PCI-BASEII/300/1000/PIO



Um eine PCIe-BASE, PCI-BASEII, PCI-BASE300, PCI-BASE1000 oder PCI-PIO mit der **LIBAD4** zu öffnen, muss an **ad_open()** der String "**pcibase**" (oder "**pci300**") übergeben werden. Beim Öffnen des Treibers wird nicht zwischen verschiedenen Versionen der PCI(e)-Messkarte unterschieden.

Mehrere Karten lassen sich durch Angabe der Kartennummer unterscheiden (1. Karte mit "**pcibase:0**", 2. Karte mit "**pcibase:1**", usw.).

Eine Messkarte kann auch direkt unter Angabe ihrer Seriennummer geöffnet werden. Die Karte mit der Seriennummer 157 lässt sich zum Beispiel mit "**pcibase:@157**" ansprechen.

6.4.1 Digitalports und Zähler

Die PCIe-BASE / PCI-BASEII/300/1000/PIO stellen zwei 16-Bit Digitalports zur Verfügung.

Die Zähler auf den PCI(e)-BASE Karten können in verschiedenen Betriebsarten verwendet werden und müssen vor der Verwendung per Software konfiguriert werden.

Jeder Eingang des Zählers kann beliebig mit einer der je 16 digitalen Leitungen der beiden Digitalports verbunden werden. Auch diese Einstellung muss vor Verwenden des Zählers konfiguriert werden (siehe "Konfiguration der Zähler", S. 84).

6.4.1.1 PCIe-BASE

Die Digitalports der PCIe-BASE sind in ihrer Richtung umschaltbar (s. "**ad_set_line_direction**", S. 40). Nach dem Einschalten steht der erste Port auf Eingang, der zweite auf Ausgang. Es wird folgende Nummerierung verwendet:

```
C      #define DIO1  (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0001)
      #define DIO2  (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0002)
```

Außerdem stellt die PCIe-BASE noch einen 32-Bit Zählereingang zur Verfügung:

```
C      #define CNT1  (AD_CHA_TYPE_COUNTER|0x0001)
```

6.4.1.2 PCI-BASEII / PCI-PIO

Die Digitalports der PCI-BASEII / PCI-PIO sind in ihrer Richtung umschaltbar (s. "ad_set_line_direction", S. 40). Nach dem Einschalten steht der erste Port auf Eingang, der zweite auf Ausgang. Es wird folgende Nummerierung verwendet:

```
C      #define DIO1  (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0001)
      #define DIO2  (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0002)
```

Außerdem stellen die PCI-BASEII / PCI-PIO drei 32-Bit Zählereingänge zur Verfügung:

```
C      #define CNT1  (AD_CHA_TYPE_COUNTER|0x0001)
      #define CNT2  (AD_CHA_TYPE_COUNTER|0x0002)
      #define CNT3  (AD_CHA_TYPE_COUNTER|0x0003)
```

6.4.1.3 PCI-BASE300 / PCI-BASE1000

Die Digitalports der PCI-BASE300 / PCI-BASE1000 sind in ihrer Richtung fest verdrahtet: der erste Port steht auf Eingang, der zweite Port auf Ausgang. Es wird folgende Nummerierung verwendet:

```
C      #define DIN   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0001)
      #define DOUT  (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0002)
```

6.4.1.4 Konfiguration der Zähler

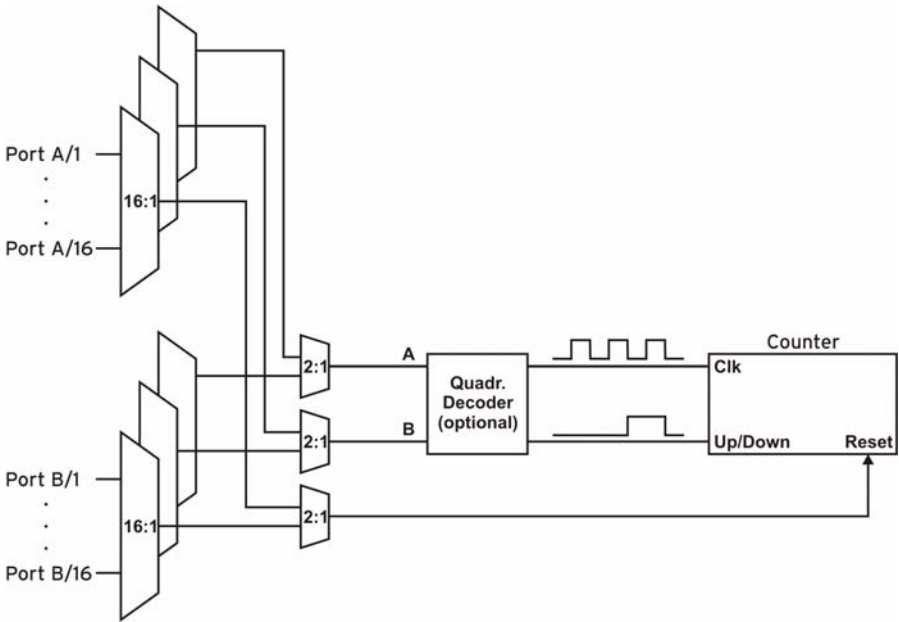


Abbildung 8

Zur Einstellung der Zähler werden die Konfigurationsparameter in die Struktur `ad_counter_mode` eingetragen und an `ad_ioctl()` übergeben.

Das folgende Beispiel zeigt das prinzipielle Vorgehen: Es konfiguriert den ersten Zähler der PCI(e)-BASE Karte in der Betriebsart "Zähler" und verbindet den Zählereingang A mit dem zweiten Eingangspin des ersten Digitalports.

| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_ioctl (int32_t adh, int32_t ioc, void *par, int32_t size);</pre> |
|------------------|--|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>#include "libad.h" ... struct ad_counter_mode par; int32_t adh; int32_t st; ... adh = ad_open ("pcibase"); memset (&par, 0, sizeof(par)); par.cha = AD_CHA_TYPE_COUNTER 1; par.mode = AD_CNT_COUNTER; par.mux_a = 1; st = ad_ioctl (adh, AD_SET_COUNTER_MODE, &par, sizeof(par)); ... ad_close (adh);</pre> |
|----------|--|

Die Struktur `ad_counter_mode` hat folgenden Aufbau:

| | |
|----------|--|
| C | <pre>struct ad_counter_mode { uint32_t cha; uint8_t mode; uint8_t mux_a; uint8_t mux_b; uint8_t mux_rst; uint16_t flags; ... };</pre> |
|----------|--|

Die Elemente der Struktur haben folgende Bedeutung:

- **cha**
Legt den Zählerkanal fest, der konfiguriert werden soll.
- **mode**
Legt die Betriebsart des Zählers fest.

| Betriebsart | Beschreibung |
|----------------------------|---|
| AD_CNT_COUNTER | Der Zählerkanal arbeitet als einfacher Zähler. Es wird nur der Eingang A des Zähler verwendet, wobei jede positive Flanke am Eingang den Zählerstand um eins erhöht. |
| AD_CNT_UPDOWN | Der Zählerkanal arbeitet als Up/Down Zähler, also mit umschaltbarer Zählrichtung. Dabei arbeitet der Eingang A des Zählers als Takteingang, der Eingang B übernimmt die Richtungumschaltung. Steht der Eingang B des Zähler auf low, dann erhöht jede positive Flanke am Eingang A den Zählerstand um eins. Ansonsten erniedrigt die positive Flanke den Zählerstand. |
| AD_CNT_QUAD_DECODER | Der Zähler decodiert an den Eingängen A und B die zwei Spuren eines Inkrementalgebers. Dabei wird jede Flanke der beiden Spuren dekodiert. |

- **mux_a, mux_b, mux_rst**
Legt die Pins der beiden Digitalports fest, die mit den jeweiligen Eingängen des Zählers verbunden sind. Dabei ist es nicht möglich, die Eingänge eines Zählers mit verschiedenen Digitalports zu verbinden (d. h. die Eingänge A, B und *Reset* müssen entweder alle mit Pins aus dem Port A verbunden sein oder alle mit Pins aus dem Port B).

| mux_a, mux_b oder mux_rst | Port/Line | mux_a, mux_b oder mux_rst | Port/Line |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 0 | PA/1 | 16 | PB/1 |
| 1 | PA/2 | 17 | PB/2 |
| 2 | PA/3 | 18 | PB/3 |
| 3 | PA/4 | 19 | PB/4 |
| 4 | PA/5 | 20 | PB/5 |
| 5 | PA/6 | 21 | PB/6 |
| 6 | PA/7 | 22 | PB/7 |
| 7 | PA/8 | 23 | PB/8 |
| 8 | PA/9 | 24 | PB/9 |
| 9 | PA/10 | 25 | PB/10 |
| 10 | PA/11 | 26 | PB/11 |
| 11 | PA/12 | 27 | PB/12 |
| 12 | PA/13 | 28 | PB/13 |
| 13 | PA/14 | 29 | PB/14 |
| 14 | PA/15 | 30 | PB/15 |
| 15 | PA/16 | 31 | PB/16 |

➤ **flags**

Legt die Arbeitsweise der Zählereingänge fest. Die Arbeitsweisen können mit **OR** verknüpft werden, z. B. **AD_CNT_INV_RST | AD_CNT_ENABLE_RST**.

| Arbeitsweise | Beschreibung |
|--------------------------|--------------------------------------|
| AD_CNT_INV_A | Zählereingang A reagiert invertiert. |
| AD_CNT_INV_B | Zählereingang B reagiert invertiert. |
| AD_CNT_INV_RST | Reseteingang reagiert invertiert. |
| AD_CNT_ENABLE_RST | Reseteingang ist aktiviert. |

6.4.2 Aufsteckmodule



Auf der PCIe-BASE / PCI-BASEII/300/1000/PIO lassen sich bis zu zwei Aufsteckmodule installieren. Diese Module stellen weitere Kanäle zur Verfügung und sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

6.4.2.1 MAD12/12a/12b/12f/16/16a/16b/16f

Der erste analoge Eingangskanal eines MAD12/12a/12b/12f/16/16a/16b/16f beginnt bei 1. Sobald ein zweites analoges Eingangsmodul auf die PCI(e)-Messkarte (nicht:PCI-PIO) gesteckt ist, wird der erste Eingang des zweiten Moduls unter der Nummer 257 (0x100+1) angesprochen.

Der Steckplatz des Moduls auf der Messkarte ist unerheblich. Lediglich die Moduladresse entscheidet über die Zuordnung der Kanäle. Beispielsweise werden einem MAD Modul mit niedrigerer Adresse die Kanäle 1 bis 16 zugewiesen (Kanalnummern 0x001 bis 0x010), dem MAD Modul mit der höheren Adresse die Kanäle 17-32 (Kanalnummern 0x101 bis 0x110).

| Modul | Analog | Kanalnummer | Messbereich | range |
|---|-------------------------------|---------------|--------------|-------|
| MAD12, MAD16 | 16 Eingänge (single-ended) | 1..16 (se) | ±1.024V | 0 |
| | 8 Eingänge (differentiell) | 17..24 (diff) | ±2.048V | 1 |
| | | | ±5.120V | 2 |
| | | | ±10.240V | 3 |
| | | | 0.06V..5.06V | 4 |
| MAD12a, MAD12f, MAD16a, MAD16f | 16 Eingänge (single-ended) | 1..16 (se) | ±1.024V | 0 |
| | 8 Eingänge (differentiell) | 17..24 (diff) | ±2.048V | 1 |
| | | | ±5.120V | 2 |
| | | | ±10.240V | 3 |
| MAD12b, MAD16b | 16 Eingänge (single-ended) | 1..16 | ±1.024V | 0 |
| | | | ±2.048V | 1 |
| | | | ±5.120V | 2 |
| | | | ±10.240V | 3 |

Damit ergeben sich für die ersten 32 Analogeingänge im single-ended Betrieb folgende Konstanten:

```

C      #define AI1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0001)
          #define AI2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0002)
          ...
          #define AI16   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0010)

          /* chas 17 to 32 only if second module present */
          #define AI17   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0101)
          #define AI18   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0102)
          ...
          #define AI32   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0110)

```

Sind die Eingangsmodule auf differentiell gejumpert, müssen die Kanalnummern 17..24 verwendet werden.

Folgende Konstanten bezeichnen die Kanäle 1..8 des ersten analogen Eingangsmoduls in der differentiellen Betriebsart:

```

C      #define AI1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0011)
          #define AI2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0012)
          ...
          #define AI8    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0018)

```

Selbstverständlich ist es möglich, ein Eingangsmodule differentiell und das zweite single-ended zu betreiben, so dass dann 24 Eingangskanäle zur Verfügung stehen.

6.4.2.2 MADDA16/16n

Der erste analoge Eingangs- oder Ausgangskanal eines MADDA16/16n beginnt bei 1. Befindet sich ein zweites Analogmodul auf der PCI(e)-Multifunktionskarte (nicht: PCI-PIO), wird der erste Eingang bzw. Ausgang des zweiten Moduls unter der Nummer 257 (0x100+1) angesprochen.

Der Steckplatz des Moduls auf der Messkarte ist unerheblich. Lediglich die Moduladresse entscheidet über die Zuordnung der Kanäle. Beispielsweise werden einem MADDA Modul mit niedrigerer Adresse die Kanäle 1 bis 16 (Analogeingänge, Kanalnummern 0x001 bis 0x010) bzw. 1 bis 2 (Analogausgänge,

Kanalnummern 0x001 bis 0x002) zugewiesen, dem MADDA Modul mit der höheren Adresse die Kanäle 17-32 (Analogeingänge, Kanalnummern 0x101 bis 0x110) bzw. 3 bis 4 (Analogausgänge, Kanalnummern 0x003 bis 0x004).

| Modul | Analog | Kanalnummer | range (Messbereich) | range (Ausgabebereich) |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---|------------------------|
| MADDA16, MADDA16n | 16 Eingänge 2 Ausgänge | 1..16 1..2 | 0 ($\pm 1.024V$) 1 ($\pm 2.048V$) 2 ($\pm 5.120V$) 3 ($\pm 10.240V$) | 0 ($\pm 10.24V$) |

Damit ergeben sich für die ersten 32 Analogeingänge folgende Konstanten:

```

C      #define AI1   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0001)
          #define AI2   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0002)
          ...
          #define AI16  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0010)

          /* chas 17 to 32 only if second MADDA module present */
          #define AI17  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0101)
          #define AI18  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0102)
          ...
          #define AI32  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0110)

```

Befinden sich zwei MADDA-Module auf der Messkarte erhalten die zwei analogen Ausgangskanäle pro MADDA-Modul die folgenden Konstanten:

```

C      #define AO1   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0001)
          #define AO2   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0002)

          /* chas 3 to 4 only if second MADDA module present */
          #define AO3   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0101)
          #define AO4   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0102)

```

6.4.2.3 MDA12/12-4/16/16-2i/16-4i/16-8i

Ebenso wie beim MAD12/12a/12b/12f/16/16a/16b/16f werden die Kanäle eines zweiten analogen Ausgangsmoduls ab der Nummer 257 (0x100+1) angesprochen.

Die Modulreihenfolge wird nur durch die Moduladresse festgelegt und nicht durch den Steckplatz auf der Trägerkarte, d. h. die Kanäle des Moduls mit der höheren Adresse beginnen ab 0x101.

| Modul | Analog | Kanalnummer | Ausgabebereich | range |
|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------|
| MDA12, MDA16 | 2 Ausgänge | 1..2 | ±10.24V ±5.12V | 0 1 |
| MDA12-4 | 4 Ausgänge | 1..4 | ±10.24V ±5.12V | 0 1 |
| MDA16-2i | 2 Ausgänge | 1..2 | ±10.24V | 0 |
| MDA16-4i | 4 Ausgänge | 1..4 | ±10.24V | 0 |
| MDA16-8i | 8 Ausgänge | 1..8 | ±10.24V | 0 |

Die Ausgabebereiche der Ausgangsmodule MDA12/MDA12-4 und MDA16 werden hardwaremäßig am Modul konfiguriert. Der Aufrufer muss sicherstellen, dass der übergebene Messbereich mit der Konfiguration auf dem Modul übereinstimmt.

Die Definition der Kanalnummern ist abhängig von der vorhandenen Kombination der Ausgabemodule auf einer Messkarte. Beispielsweise ergibt sich für ein MDA16-2i und einem MDA16-4i Ausgabemodul auf einer Messkarte die folgende Kanalnummernzuordnung:

```

C      /* for example a PCI-BASEII with an MDA16-2i (module
          * address 2) and an MDA16-4i (address 3) */

          /* MDA16-2i with module address 2 (2 chas) /
          #define AO1  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0001)
          #define AO2  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0002)

          /* MDA16-4i with module address 3 (4 chas)
          #define AO3  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0101)
          #define AO4  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0102)
          #define AO5  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0103)
          #define AO6  (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0104)

```

6.4.2.4 Funktionsgenerator der MDA16i-2i/-4i/-8i

Die Ausgabemodule MDA16-2i/-4i/-8i enthalten einen Funktionsgenerator, mit dem periodische Signalformen ausgegeben werden können.

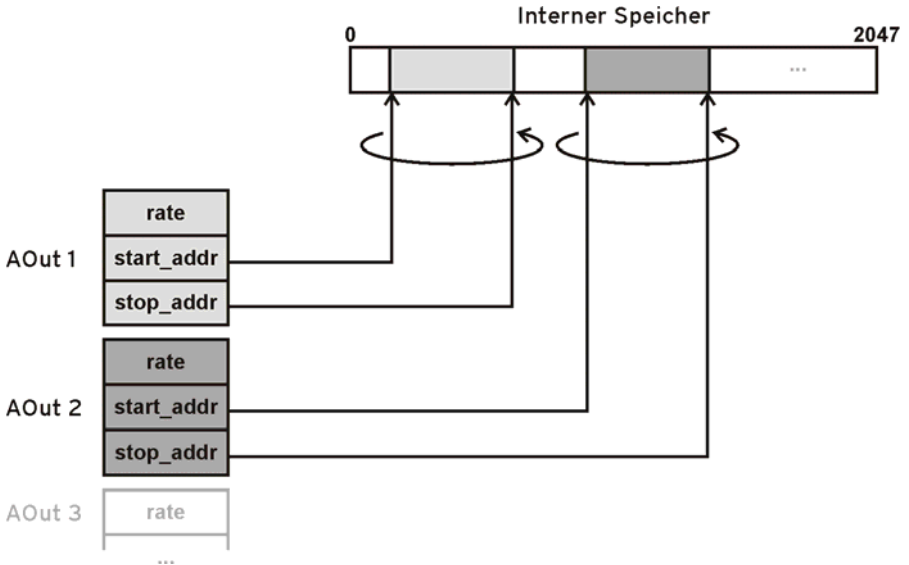


Abbildung 9

Dazu existiert auf dem Modul ein Speicher für 2048 Messwerte, in den beliebige Signalformen geladen werden können. Jeder Ausgabekanal der MDA16-2i/-4i/-8i Module besitzt einen eigenen Controller, der einen beliebigen Speicherbereich des internen Speichers ausgeben kann. Sowohl der Speicherbereich als auch die Ausgabefrequenz lässt sich dabei für jeden Kanal getrennt einstellen.

Zur Konfiguration der einzelnen Kanäle werden die Parameter in die Struktur `ad_mda2_generator` eingetragen und mit Hilfe von `ad_ioctl()` übergeben.

Die Struktur **ad_mda2_generator** erlaubt die Definition der Parameter für alle Ausgabekanäle eines Moduls und hat folgenden Aufbau:

```
C      struct ad_mda2_generator
      {
          uint32_t cha;
          uint32_t chac;
          struct ad_mda2_generator_cha chav[16];
          uint32_t ram[2048];
      };
```

Die Elemente der Struktur haben folgende Bedeutung:

- **cha**
Ausgabekanal des Moduls: Legt fest auf welchem Modul die Ausgabeparameter verändert werden sollen, z. B. für das erste Modul auf einer Messkarte (**AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT | 0x0001**) und für ein eventuell vorhandenes zweites Modul (**AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT | 0x0101**).
- **chac**
Anzahl der zu definierenden Ausgabecontroller
- **chav**
Ausgabeparameterstrukturen der zu definierenden Ausgabecontroller
- **ram**
Speicher mit Ausgabewerten für die Analogausgabe: Die Analogausgabe ist linear skaliert, wobei der Wert **0x00000000** eines Analogausgangs der niedrigsten Ausgangsspannung, der Wert **0xffffffff** der höchsten Ausgangsspannung entspricht. Mittels **ad_float_to_sample()** lässt sich ein Spannungswert (float) in einen Ausgabewert umrechnen.

Die Struktur **ad_mda2_generator_cha** erlaubt die Definition der Parameter für einen Ausgabekanal und hat folgenden Aufbau:

```
C      struct ad_mda2_generator_cha
      {
          uint32_t cha;
          uint32_t range;
          uint32_t rate;
          uint32_t start_addr;
          uint32_t stop_addr;
      };
```

Die Speicherdaten von der Startadresse **start_addr** bis zur Stopadresse **stop_addr** werden periodisch vom Ausgabecontroller **cha** unter Berücksichtigung der eingestellten Ausgaberate **rate** auf dem Ausgabekanal ausgegeben. Die jeweiligen Start- und Stopadressen der Ausgabecontroller dürfen sich nicht überlappen.

Die Elemente der Struktur haben folgende Bedeutung:

- **cha**
Controllernummer des Ausgabekanal: Jedes Modul besitzt einen Controller pro Analogausgang. Die Controllernummer wird von 0 ab indiziert (z. B. für einem MDA16-4i mit 4 Ausgabekanal stehen die Controllernummern 0 bis 3 zur Verfügung). Die Controllernummer 0 entspricht Analogausgang 1, usw.
- **range**
Messbereichsnummer der Ausgabe: Bei einem MDA16-2i/4i/8i mit $\pm 10.24V$ Messbereich ist die Messbereichsnummer 0.
- **rate**
Teiler für die Ausgabefrequenz: Der Ausgabecontroller wird mit einer Ausgabefrequenz betrieben, die sich aus der maximalen Ausgabefrequenz des Moduls geteilt durch **rate** ergibt. Bei einem MDA16-2i/4i/8i beträgt die maximale Ausgabefrequenz 100kHz. Eine **rate** von 100 wird zu einer Ausgabeauflösung von 1kHz bzw. 1ms pro Ausgabepunkt führen.
- **start_addr**
Startadresse im Speicherbereich des Moduls

➤ **stop_addr**

Stopadresse im Speicherbereich des Moduls

Das folgende Beispiel zeigt das prinzipielle Vorgehen:

| | |
|------------------|--|
| Prototype | <pre>int32_t ad_ioctl1 (int32_t adh, int32_t ioc, void *par, int32_t size);</pre> |
|------------------|--|

| | |
|----------|--|
| C | <pre>#include "libad.h" #include "libad_mda2.h" ... struct ad_mda2_generator gen; unsigned j, N = 1000; float v; double PI = 3.141; int rc; uint32_t tmp; memset(&gen, 0, sizeof(gen)); /* define the analog output modul / gen.cha = AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 1; /* using 2 output controller */ gen.chac = 2; /* fill two areas in the modul ram, * 1st area 0..499 with a full sinus, * 2nd area 500 to 999 with a ramp */ for (j = 0; j < 500; j++) { v = (float) (10*sin (j * ((2.0*PI) / 500))); ad_float_to_sample(adh, AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 1, 0, v, &tmp); gen.ram[j] = tmp; } for (j = 500; j < 1000; j++) { v = (float) (-1.0 + (j-500) * 2.0 / 500); ad_float_to_sample(adh, AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT 2, 0, v, &tmp); gen.ram[j] = tmp;</pre> |
|----------|--|

```
    }  
  
    gen.chav[0].cha = 0;  
    /* rate 10kHz (100kHz/10) with 500 points  
     * => 50 ms duration */  
    gen.chav[0].rate = 10;  
    gen.chav[0].start_addr = 0;  
    gen.chav[0].stop_addr = 499;  
  
    gen.chav[1].cha = 1;  
    /* rate 1kHz (100kHz/100) with 500 points  
     * => 500 ms duration */  
    gen.chav[1].rate = 100;  
    gen.chav[1].start_addr = 500;  
    gen.chav[1].stop_addr = 999;  
  
    rc = ad_ioctl (adh, AD_MDA2_SET_GENERATOR, &gen,  
sizeof(gen));  
  
    rc = ad_ioctl (adh, AD_MDA2_START_GENERATOR, &gen,  
sizeof(gen));
```

6.5 meM-AD /-ADDA /-ADf / -ADfo



Um ein meM-AD/-ADDA/-ADf/-ADfo mit der **LIBAD4** zu öffnen, muss an `ad_open()` der String **"memadusb"** (meM-AD), **"memaddausb"** (meM-ADDA), **"memadfusb"** (meM-ADf) bzw. **"memadfpsub"** (meM-ADfo) übergeben werden. Mehrere USB Messsysteme lassen sich durch Angabe der Gerätenummer öffnen (z. B. 1. Gerät mit **"memadusb:0"**, 2. Gerät mit **"memadusb:1"**, usw.). Die Reihenfolge der Geräte wird durch das Anstecken bestimmt.

Da USB Messsysteme im Betrieb an- und abgesteckt werden können, ist es möglich, dass die Gerätenummern nicht aufeinander folgend vergeben sind. Steckt man z. B. drei meM-ADDA an und entfernt dann das 2. Gerät, sind die verbleibenden meM-ADDA mit **"memaddausb:0"** und **"memaddausb:2"** anzusprechen.

Um unabhängig von dieser Ansteckreihenfolge zu sein, kann ein Gerät auch mit einer bestimmten Seriennummer geöffnet werden. Das Gerät mit der Seriennummer 157 lässt sich zum Beispiel mit **"memadfpsub:@157"** ansprechen.

6.5.1 Eckdaten und Kanalnummern meM-Geräte

| Messsystem | Analog | Kanalnummer | Eing./Ausg.-bereich | range | Digital | Kanalnummer |
|------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|--|
| meM-AD | 16 Eingänge | 1..16 | ±5.12V | 0 | - | - |
| meM-ADDA, meM-ADf | 16 Eingänge 1 Ausgang | 1..16 1 | ±5.12V | 0 | 2 Ports (je 4 Bit) | 1: Eingang (Bit 0..3) 2: Ausgang (Bit 0..3) |
| meM-ADfo | 16 Eingänge 1 Ausgang | 1..16 1 | ±5.12V | 0 | 2 Ports (je 8 Bit) | 1: Eingang (Bit 0..7) 2: Ausgang (Bit 0..7) |

Der erste analoge Eingangskanal eines meM-AD/-ADDA/-ADf/-ADfo beginnt bei 1. Damit ergeben sich für die 16 Analogeingänge folgende Konstanten:

```
C      #define AI1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0001)
      #define AI2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0002)
      ...
      #define AI16   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0010)
```

Der analoge Ausgangskanal eines meM-ADDA/-ADf/-ADfo erhält die folgende Konstante:

```
C      #define AO1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0001)
```

Die Richtung der Digitalports ist nicht umschaltbar. Dabei stehen die 4 (meM-ADfo: 8) Leitungen des 1. Ports (DIO1) auf Eingang, die 4 (meM-ADfo: 8) Leitungen des 2. Ports (DIO2) auf Ausgang. Es ergeben sich folgende Konstanten:

```
C      #define DIO1   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0001)
      #define DIO2   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0002)
```

6.6 meM-PIO / meM-PIO-OEM



Um eine meM-PIO/meM-PIO-OEM mit der **LIBAD4** zu öffnen, muss an **ad_open()** der String **"mempiousb"** übergeben werden. Mehrere USB Messsysteme lassen sich durch Angabe der Gerätenummer öffnen (1. Gerät mit **"mempiousb:0"**, 2. Gerät mit **"mempiousb:1"**, usw.). Die Reihenfolge der Geräte wird durch das Anstecken bestimmt.

Da die USB Messsysteme im laufenden Betrieb an- und wieder abgesteckt werden können, ist es möglich, dass die Geräteummern nicht in aufsteigender Reihenfolge vergeben sind. Werden beispielsweise drei Geräte angesteckt und dann das zweite Gerät wieder abgesteckt, sind die beiden verbleibenden Geräte mit **"mempiousb:0"** und **"mempiousb:2"** anzusprechen.

Um unabhängig von dieser Ansteckreihenfolge zu sein, kann ein Gerät auch mit einer bestimmten Seriennummer geöffnet werden. Das Gerät mit der Seriennummer 157 lässt sich zum Beispiel durch Angabe von **"mempiousb:@157"** ansprechen.

6.6.1 Eckdaten und Kanalnummern meM-PIO(-OEM)

| Messsystem | Digital | Kanalnummer |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| meM-PIO, meM-PIO-OEM | 3 Ports (je 8 Bit) | 1..3 (Bit 0..7) |

Die Richtung der Leitungen ist für jeden Port getrennt einstellbar. Die Umstellung erfolgt portweise (s. **"ad_set_line_direction"**, S. 40).

```

C      #define DIO1    (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO | 0x0001)
          #define DIO2    (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO | 0x0002)
          #define DIO3    (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO | 0x0003)

```

6.7 USB-AD / USB-PIO / USB-PIO-OEM



Um ein USB-AD oder eine USB-PIO/USB-PIO-OEM mit der **LIBAD4** zu öffnen, muss an `ad_open()` der String "**usb-ad**" bzw. "**usb-pio**" übergeben werden. Mehrere USB Messsysteme lassen sich durch Angabe der Gerätenummer öffnen (1. Gerät mit "**usb-ad:0**", 2. Gerät mit "**usb-ad:1**", usw., bzw. 1. Gerät mit "**usb-pio:0**", 2. Gerät mit "**usb-pio:1**", usw.). Die Reihenfolge der Geräte wird durch das Anstecken bestimmt.

Da USB Messsysteme im Betrieb an- und abgesteckt werden können, ist es möglich, dass die Gerätenummern nicht aufeinander folgend vergeben sind. Steckt man z. B. drei USB-AD an und entfernt dann das 2. Gerät, sind die verbleibenden USB-AD mit "**usb-ad:0**" und "**usb-ad:2**" anzusprechen.

Um unabhängig von dieser Ansteckreihenfolge zu sein, kann ein Gerät auch mit einer bestimmten Seriennummer geöffnet werden. Das Gerät mit der Seriennummer 157 lässt sich zum Beispiel mit "**usb-ad:@157**" bzw. "**usb-pio:@157**" ansprechen.



Das USB-AD bzw. die USB-PIO/USB-PIO-OEM implementiert die CDC Klasse als ACM. Für diese Geräte bietet FreeBSD einen entsprechenden Treiber an, so dass die Geräte direkt von FreeBSD unterstützt werden. Dazu muss der `umodem` Treiber geladen sein:

```
bash# kldload umodem
bash#
```

Um ein USB-AD oder eine USB-PIO/USB-PIO-OEM mit der **LIBAD4** zu öffnen, muss an `ad_open()` der String "**usb-ad**" bzw. "**usb-pio**" übergeben werden. Unter FreeBSD öffnet die **LIBAD4** daraufhin das Device `"/dev/cuaU0"`, um mit dem USB-AD bzw. USB-PIO/USB-PIO-OEM zu kommunizieren. Es ist Aufgabe der Applikation, sicherzustellen, dass als `"/dev/cuaU0"` ein USB-AD bzw. eine USB-PIO/USB-PIO-OEM angemeldet ist.

Mehrere USB Messsysteme lassen sich durch Angabe der Gerätenummer öffnen (1. Gerät mit "**usb-ad:0**", 2. Gerät mit "**usb-ad:1**", usw., bzw. 1. Gerät mit "**usb-pio:0**", 2. Gerät mit "**usb-pio:1**", usw.). Die **LIBAD4** öffnet daraufhin das Device **"/dev/cuaU0"** und **"/dev/cuaU1"**.

Neben der automatischen Vergabe der Devicenamen lässt sich unter FreeBSD auch das verwendete Device direkt angeben. Beim Aufruf von **ad_open** ("**usb-ad:/dev/cuaU12**" bzw. "**usb-pio:/dev/cuaU12**") öffnet die **LIBAD4** das Device **"/dev/cuaU12"**.



Das USB-AD bzw. die USB-PIO/USB-PIO-OEM implementiert die CDC Klasse als ACM. Für diese Geräte bietet Linux einen entsprechenden Treiber an, so dass die Geräte direkt von Linux unterstützt werden, wenn das Kernel entsprechend konfiguriert ist.

Um ein USB-AD oder eine USB-PIO/USB-PIO-OEM mit der **LIBAD4** zu öffnen, muss an **ad_open()** der String "**usb-ad**" bzw. "**usb-pio**" übergeben werden. Unter Linux öffnet die **LIBAD4** daraufhin das Device **"/dev/ttyACM0"**, um mit dem USB-AD bzw. der USB-PIO/USB-PIO-OEM zu kommunizieren. Es ist Aufgabe der Applikation, sicherzustellen, dass als **"/dev/ttyACM0"** ein USB-AD bzw. eine USB-PIO/USB-PIO-OEM angemeldet ist.

Mehrere USB Messsysteme lassen sich durch Vergabe des Devicenamens öffnen.

Beim Aufruf von **ad_open** ("**usb-ad:/dev/ttyACM12**" bzw. "**usb-pio:/dev/ttyACM12**") öffnet die **LIBAD4** das Device **"/dev/ttyACM12"**.

6.7.1 Eckdaten und Kanalnummern USB-AD

| Messsystem | Analog | Kanalnummer | range (Messber.) | range (Ausgabebereich) | Digital | Richtung |
|------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| USB-AD | 16 Eingänge 1 Ausgang | 1..16 1 | 0 (±5.12V) | 0 (±5.12V) | 2 Ports (je 4 Bit) | 1: Eingang (Bit 0..3) 2: Ausg. (Bit 0..3) |

Der erste analoge Eingangskanal eines USB-AD beginnt bei 1. Damit ergeben sich für die 16 Analogeingänge folgende Konstanten:

```
C      #define AI1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0001)
      #define AI2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0002)
      ...
      #define AI16   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0010)
```

Der analoge Ausgangskanal eines USB-AD erhält die folgende Konstante:

```
C      #define AO1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0001)
```



Aus Kompatibilitätsgründen lässt sich für die Anlogeingänge auch der Messbereich 33 und für den Analogausgang der Ausgabebereich 1 angeben.

Die Richtung der digitalen Portleitungen ist nicht umschaltbar. Dabei stehen die 4 Leitungen des ersten Ports (DIO1) auf Eingang, die 4 Leitungen des zweiten Ports (DIO2) auf Ausgang. Für die Kanäle ergeben sich folgende Konstanten:

```
C      #define DIO1   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0001)
      #define DIO2   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0002)
```

6.7.2 Eckdaten und Kanalnummern USB-PIO(-OEM)

| Messsystem | Digital | Kanalnummer |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| USB-PIO, USB-PIO-OEM | 3 Ports (je 8 Bit) | 1..3 (Bit 0..7) |

Die Richtung der Leitungen ist für jeden Port getrennt einstellbar. Die Umstellung erfolgt portweise (s. "`ad_set_line_direction`", S. 40).

```
C      #define DIO1    (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0001)
      #define DIO2    (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0002)
      #define DIO3    (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0003)
```

6.8 USB-AD12f



Um ein USB-AD12f mit der **LIBAD4** zu öffnen, muss an `ad_open()` der String "`usbad12f`" übergeben werden. Mehrere USB Messsysteme lassen sich durch Angabe der Gerätenummer öffnen (1. Gerät mit "`usbad12f:0`", 2. Gerät mit "`usbad12f:1`", usw.). Die Reihenfolge der Geräte wird durch das Anstecken bestimmt.

Da USB Messsysteme im Betrieb an- und abgesteckt werden können, ist es möglich, dass die Gerätenummern nicht aufeinander folgend vergeben sind. Steckt man z. B. drei USB-AD12f an und entfernt dann das 2. Gerät, sind die verbleibenden USB-AD12f mit "`usbad12f:0`" und "`usbad12f:2`" anzusprechen.

Um unabhängig von dieser Ansteckreihenfolge zu sein, kann ein Gerät auch mit einer bestimmten Seriennummer geöffnet werden. Das Gerät mit der Seriennummer 157 lässt sich zum Beispiel mit "`usbad12f:@157`" ansprechen.

6.8.1 Eckdaten und Kanalnummern USB-AD12f

| Messsystem | Analog | Kanalnummer | range (Messber.) | range (Ausgabebereich) | Digital | Richtung |
|------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| USB-AD12f | 16 Eingänge 1 Ausgang | 1..16 1 | 0 (±10.24V) | 0 (±5.12V) | 2 Ports (je 4 Bit) | 1: Eingang (Bit 0..3) 2: Ausg. (Bit 0..3) |

Der erste analoge Eingangskanal eines USB-AD12f beginnt bei 1. Damit ergeben sich für die 16 Analogeingänge folgende Konstanten:

```
C      #define AI1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0001)
      #define AI2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0002)
      ...
      #define AI16   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0010)
```

Der analoge Ausgangskanal eines USB-AD12f erhält die folgende Konstante:

```
C      #define AO1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0001)
```

Die Richtung der digitalen Portleitungen ist nicht umschaltbar. Dabei stehen die 4 Leitungen des ersten Ports (DIO1) auf Eingang, die 4 Leitungen des zweiten Ports (DIO2) auf Ausgang. Für die Kanäle ergeben sich folgende Konstanten:

```
C      #define DIO1   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0001)
      #define DIO2   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0002)
```

Bei dem Digitaleingang wird die Eingangsleitung 1 gleichzeitig auch als Zähler benutzt. Der Zähler wird mit der folgenden Kanalkonstanten angesprochen:

```
C      #define CNT1   (AD_CHA_TYPE_COUNTER|0x0001)
```

6.9 USB-AD16f



Um ein USB-Messsystem vom Typ USB-AD16f mit der **LIBAD4** zu öffnen, muss an `ad_open()` der String `"usbbase"` übergeben werden. Mehrere USB-AD16f Messsysteme lassen sich durch Angabe der Gerätenummer öffnen (1. Gerät mit `"usbbase:0"`, 2. Gerät mit `"usbbase:1"`, usw.). Die Reihenfolge der Geräte wird durch das Anstecken bestimmt.

Da USB Messsysteme im Betrieb an- und abgesteckt werden können, ist es möglich, dass die Gerätenummern nicht aufeinander folgend vergeben sind. Steckt man z. B. drei USB-AD16f an und entfernt dann das 2. Gerät, sind die verbleibenden USB-AD16f mit `"usbbase:0"` und `"usbbase:2"` anzusprechen.

Um unabhängig von dieser Ansteckreihenfolge zu sein, kann ein Gerät auch mit einer bestimmten Seriennummer geöffnet werden. Das Gerät mit der Seriennummer 157 lässt sich zum Beispiel mit `"usbbase:@157"` ansprechen.

6.9.1 Eckdaten und Kanalnummern USB-AD16f

| Messsystem | Analog | Kanalnummer | range (Messber.) | range (Ausgabebereich) | Digital | Richtung |
|------------------|---------------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------------|--|
| USB-AD16f | 16 Eingänge 2 Ausgänge | 1..16 1 .. 2 | 0 ($\pm 1.024V$) 1 ($\pm 2.048V$) 2 ($\pm 5.12V$) 3 ($\pm 10.24V$) | 0 ($\pm 10.24V$) | 2 Ports (je 4 Bit) | 1: Eingang (Bit 0..3) 2: Ausg. (Bit 0..3) |

Die 16 Analogeingänge eines USB-AD16f besitzen die Kanalnummern 1-16. Die beiden Analogausgänge haben die Kanalnummern 1 und 2.

Damit ergeben sich für die 16 Analogeingänge folgende Konstanten:

```
C      #define AI1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0001)
      #define AI2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0002)
      ...
      #define AI16   (AD_CHA_TYPE_ANALOG_IN|0x0010)
```

Die beiden analogen Ausgangskanäle eines USB-AD16f erhalten die folgenden Konstanten:

```
C      #define AO1    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0001)
      #define AO2    (AD_CHA_TYPE_ANALOG_OUT|0x0002)
```

Die Richtung der digitalen Portleitungen ist nicht umschaltbar. Dabei stehen die 4 Leitungen des ersten Ports (DIO1) auf Eingang, die 4 Leitungen des zweiten Ports (DIO2) auf Ausgang. Für die Kanäle ergeben sich folgende Konstanten:

```
C      #define DIO1   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0001)
      #define DIO2   (AD_CHA_TYPE_DIGITAL_IO|0x0002)
```

Außerdem besitzt das USB-AD16f einen Zählereingang, für den sich die folgende Konstante ergibt:

```
C      #define CNT1   (AD_CHA_TYPE_COUNTER|0x0001)
```

7 Index

3

32-Bit 7

6

64-Bit 7

A

Abtastrate 47, 54
 Abtasttakt 45, 58, 59
 Abtastzeit 42, 68
 ad_analog_in () 37
 ad_analog_out () 27
 ad_calc_run_size () 68
 ad_close () 24
 ad_digital_in () 38
 ad_digital_out () 38
 ad_discrete_in () 26
 ad_discrete_in64 () 27
 ad_discrete_inv () 29
 ad_discrete_out () 30
 ad_discrete_out64 () 31
 ad_discrete_outv () 33
 ad_float_to_sample () 35
 ad_float_to_sample64 () 36
 ad_get_digital_line () 39
 ad_get_drv_version () 41
 ad_get_line_direction () 39
 ad_get_next_run () 69
 ad_get_next_run_f () 70
 ad_get_next_run_f64 () 70
 ad_get_range_count () 24
 ad_get_range_info () 25
 ad_get_sample_layout () 63
 ad_get_samples () 64
 ad_get_samples_f () 65
 ad_get_samples_f64 () 66
 ad_get_version () 40
 ad_open () 20, 22
 ad_poll_scan_state () 71

ad_sample_to_float () 33
 ad_sample_to_float64 () 34
 ad_set_digital_line () 38
 ad_set_line_direction () 40
 ad_start_mem_scan () 61
 ad_start_scan () 62
 ad_stop_scan () 72
 Analogausgang
 mehrere setzen 33
 setzen 30, 31
 Anzahl der Messwerte 42, 44, 47, 49, 54
 Ausgaberichtung 40
 Ausgang
 mehrere setzen 33
 setzen 30, 31
 Ausgangsbereich 30, 31, 33, 73
 Ausangsleitung 39
 Auslesen der Messwerte 51

B

Buffer 20, 42, 47, 52, 68
 buffer_start 64
 bytes_per_run 47, 68

C

cha 43, 80, 86, 93, 94
 chac 93
 chav 93

D

differentiell 89
 Digitalkanal
 Richtung abfragen 39
 Richtung setzen 40

E

Effektivwert 43
 Eingaberichtung 40
 Eingänge

Reihenfolge 62, 63
Eingangsleitung 39
Einzelwert
 abfragen 26, 27
 mehrere abfragen 29
Ergebnis 72

F

Fehlernummer 20, 22, 72
Fenstertrigger 46
flags 48, 49, 81, 87
Flankentrigger 46
FreeBSD 7, 14

G

GetLastError 20, 22
Groß-/Kleinschreibung 20, 22

H

Headerdatei 19

I

iM-3250 74
iM-3250T 74
iM-AD25 74
iM-AD25a 74
Installation
 FreeBSD 14
 Linux 16
 Mac OS X 11
 Windows® 11
Internetadresse 9

K

Kanalart 73
Kanalnummer 26, 27, 29, 30, 31, 33, 42,
 43, 73
kontinuierliche Messung 47, 54

L

LAN-AD16f 77

Digitalports 78
Kanalnummer 77
Zähler 78
Linux 7, 16

M

Mac OS X 7, 11
MAD12 88
MAD12a 88
MAD12b 88
MAD12f 88
MAD16 88
MAD16a 88
MAD16b 88
MAD16f 88
MADDA16 89
MADDA16n 89
Maximum 44
MDA12 91
MDA12-4 91
MDA16 91
MDA16-2i 91
MDA16-4i 91
MDA16-8i 91
meM-AD 97
meM-ADDA 97
meM-ADf 97
meM-ADfo 97
meM-Geräte
 Digitalports 99
 Reihenfolge 97, 99
 Seriennummer 97, 99
memory-only Messung 61, 69, 70, 71
meM-PIO 99
meM-PIO-OEM 99
Messbereich 26, 27, 29, 43, 73
 Anzahl 24
 Information 25
Messbereichsgrenze 26, 69
Messbereichsmitte 27, 28
Messsystem
 mehrere gleiche öffnen 22
 mehrere verschiedene öffnen 20, 22
 Name 20
 öffnen 19, 22
 schließen 19, 24
Messung

- kontinuierlich 42, 54
- memory-only 42
- mit Trigger 60
- Messwert 30, 32, 33, 34, 35, 36, 69
 - auslesen 60
- Minimum 44
- Mittelwert 44
- mode 80, 86
- mux_a 80, 86
- mux_b 80, 86
- mux_rst 80, 86

N

- Nachgeschichte 47, 60
 - Anzahl Messwerte 64
- Name 20
- network byte order 69
- Nullpegel 43

O

- oder-Operator (!) 73

P

- PCI-BASE1000 82
 - Digitalports 83
- PCI-BASE300 82
 - Digitalports 83
- PCI-BASEII 82
 - Digitalports 83
- PCIe-BASE 82
 - Digitalports 82
- PCIe-Karten
 - Seriennummer 82
- PCI-PIO 82
 - Digitalports 83
- posthist 47, 49
- posthist_samples 64
- Posthistory 60
- prehist 47
- prehist_samples 64
- Prehistory 60

R

- ram 93
- range 43, 94
- rate 94
- ratio 43
- Richtung 39
- RMS 43, 44
- RUN 49, 54, 56, 58, 62, 68
- runs_pending 49

S

- sample_rate 47, 68
- samples_per_run 44, 47, 68
- Scan 20, 42
 - erster Messwert 64
 - Parameter 42
 - starten 50
 - stoppen 53
 - Zustand 60
- Scanparameter 42
- Seriennummer 82, 97, 99, 100, 103, 105
- single-ended 89
- Spannungswert 33, 34, 35, 36, 51
- Speicherart 43, 44
- Speicherintervall 43
- Speicherrate 58
- start 64
- start_addr 94
- Starten des Scans 50
- stop_addr 95
- Stoppen des Scans 53, 72
- store 43
- struct ad_scan_cha_desc 43
- struct ad_scan_desc 46
- struct ad_scan_state 48

T

- ticks_per_run 47, 68
- Treiberversion 41
- trg_mode 44
- trg_par 44
- Trigger 44, 45, 47, 49, 60
 - Bedingung 45, 60
 - Einstellungen 42

Fenster 46
Flanke 46
Parameter 44

U

Überlauf der Messwerte 42, 54, 72
Umrechnung
 Messwert in Spannungswert 33, 34
 Spannungswert Messwert 35, 36
Urheberrechte 10
USB-AD 100
 Digitalports 102
 Kanalnummer 102
 Reihenfolge 100
 Seriennummer 100
USB-AD12f 103
 Digitalports 104
 Kanalnummer 104
 Reihenfolge 103
 Seriennummer 103
USB-AD16f 105
 Digitalports 106
 Kanalnummer 105
 Seriennummer 105
USB-AD16f
 Reihenfolge 105
USB-PIO 100
 Digitalports 103
 Kanalnummer 103

Reihenfolge 100
Richtung 103
Seriennummer 100
USB-PIO-OEM 100
 Digitalports 103
 Kanalnummer 103
 Reihenfolge 100
 Richtung 103
 Seriennummer 100

V

Version
 LIBAD4.DLL 40
 Treiber 41
Vorgeschichte 47, 60
 Anzahl Messwerte 64
 erster Messwert 64

W

Windows® 7, 11

Z

Zähler
 Konfiguration 79, 84
Zeiger 51, 61
zero 43
Zustand der Messung 49, 71